



VISTOS

1. La Constitución Política de la República;
2. La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
3. La Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
4. La Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal;
5. La Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y sus modificaciones;
6. Decreto Ley 3063/1979 sobre Rentas Municipales
7. Licitación Pública ID 1596-15-LP23, Resolución (E) del Gobierno Regional del maule N° 2816 de fecha 3 de mayo del 2023, por el cual adjudica e instruye emitir Orden de Compra en Portal www.mercadopublico.cl, y Orden de Compra 1596-146-SE23 sobre la adquisición del proyecto "REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPT. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE" COD BIP 40.026.686-0.
8. Copia de permiso de circulación FOLIO 2612526 de fecha 28 de junio del 2023, que refleja el pago hasta el día 31/08/2023 del vehículo PPU SVPL98-2, Ambulancia de marca Mercedes Benz, Modelo Sprinter 416 CDI EURO V año 2023.
9. Decreto Alcaldicio 10/2024, por el cual el Alcalde delega facultades al Administrador Municipal, y autoriza su firma "Por orden del Alcalde".
10. Decreto Alcaldicio 1608/2021 que regula la subrogancia en el ejercicio de los cargos nominados e innominados que indica, y el Decreto Alcaldicio 2530 de fecha 13 de Diciembre del 2023, que lo modifica en lo relacionado al cargo de Secretaria Municipal.

CONSIDERANDO

1. La Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, recibió en beneficio del Departamento Comunal de Salud, una ambulancia proveniente del proyecto código BIP 40.026.686-0, denominado "REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPT. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE" el cual fue entregado por la empresa proveedora BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA, RUT 87.927.900-3, con un permiso de circulación que se encontró vigente solo hasta el día 31/08/2023, lo que no fue advertido oportunamente si no hasta fines del mes de Diciembre del 2023, frente a lo cual es necesario efectuar el pago de la cuota pendiente.
2. Que, en virtud de tales antecedentes, paso a decretar la rectificación del acto administrativo en comento, al tenor de lo que a continuación se indicará:

DECRETO:

Exento del Trámite
de Registro

1. **AUTORÍCESE** el pago del permiso de circulación del vehículo PPU SVPL98-2, correspondiente a Ambulancia de marca Mercedes Benz, Modelo Sprinter 416 CDI EURO V año 2023 del departamento Comunal de Salud, por el periodo restante al permiso de circulación del año 2023, conforme a información adjunta obtenida del portal de pago de permiso de circulación de la Ilustre Municipalidad de Renca. (REF. al 25/01/2024, \$805.923 ochocientos cinco mil novecientos veintitrés pesos).



2. **IMPÚTESE** el gasto correspondiente a este pago a la cuenta presupuestaria respectiva.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE AL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD, ENCARGADO DE CONTABILIDAD, MOVILIZACIÓN CESFAM JORGE DEL CAMPO AMARO Y ARCHÍVESE.


MUNICIPALIDAD DE VILLA ALENDRÉ
SECRETARÍA MUNICIPAL
NICOL ARCE BRAVO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
MINISTRA DE FE

FPF/NAB/JCF/AMH/cdb
DECRETO 110


MUNICIPALIDAD DE VILLA ALENDRÉ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FRANCISCO PARRA FLORES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
"POR ORDEN DEL ALCALDE"

FOLIO 2612526

COMPONENTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

MUNICIPALIDAD DE RENCA

ANO 2023

FECHA 28/06/2023

PLACA UNICA SVPL98-2

NOMBRE ANOTACION MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DOMICILIO AV. ESPAÑA 196

VEHICULO AMBULANCIA

MARCA MERCEDES BENZ

CHASIS 8AC907643PE213268

SECCION VERDE-0

C.C. 2143

PTA 5

CLASE D

AST 2

TRANS M

EQUIP F

CARGA 0,00

TASACION 64.789,916

PAGO EN CUENTAS 735.730

ANO

COMUNA INTERIOR

MULTAS

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

PERMISO DE CIRCULACION 1

MUNICIPALIDAD DE RENCA

ANO 2023

VEHICULO AMBULANCIA

MARCA MERCEDES BENZ

MODELO SPRINTER 416 CDI EURO V

MOTOR 651958W0134917

PTS 5

CONTRIBUYENTE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

R.U.T. 66.130.200-8

MULTAS

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.



31/08/2023

Verificar en www.renca.cl ID: a910e-002r1

FOLIO 2612526

Digitally signed by
DAVID YAGLENE FERRERA BARRIOS
DN: cn=DAVID YAGLENE FERRERA BARRIOS,
ou=RENCA, o=RENCA



FIRMA Y TIMBRE CUALIFICADO

PLACA UNICA SVPL98-2

CODIGO S.I.I


PERMISO PAGADO

PERIODO HASTA 31/08/2023

TOTAL A PAGAR 735.730

Verificar en www.renca.cl ID: a910e-002r1

Servicios On Line > Pago de Permiso de Circulación



A.- Antecedentes del propietario

R.U.T.: **69130200-8**
 Nombre: **MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE**
 Dirección: **AV. ESPAÑA 196**
 Comuna: **VILLA ALEGRE**
 Teléfono:
 Email:

B.- Antecedentes del vehículo

Placa:	SVPL98	Tipo Veh.:	AMBULANCIA
Marca:	MERCEDES BENZ	Modelo:	SPRINTER 416 CDI EURO V
Año Fab.:	2023	Color:	BLANCO ARTICO
Puertas:	5	Cilindrada:	2143
Equip.:	FULL	Combust.:	DIES
Transmisión:	MEC	Motor:	651958W0134917
Cod. SII.:		Tasación:	64789916

C.- Detalle para pago

A continuación se presentan los conceptos disponibles para pago.

Concepto	Descripción	Nota	Reajuste	Intereses	Total	Paga
Permiso de Circulación	2da. Cuota Año 2023	732.841	16.855	56.227	805.923	<input checked="" type="checkbox"/>

Total a pagar: **\$805.923**

D.- Datos de contacto

A continuación se presentan los datos de contacto. Por favor ratifique esta información antes de realizar el pago.

* Nombres:
 * Apellidos:
 * Dirección:
 Villa/Sector:
 * Comuna:
 * Teléfono:
 Teléfono móvil:
 * Email:

* Email
(confirmación):

Ratifico datos.

(*) Obligatorio

[Siguiente](#)

by SMC LTDA

Rut : 72.227.000-2
Dirección Demandante : 1 NORTE #711, TALCA.
Teléfono : 56-71-2965378

Demandante : GOBIERNO REGIONAL VII REGION
Unidad de Compra : Gobierno Regional del Maule
Fecha Envío OC. : 19-05-2023 12:38:06
Estado : Recepcion Conforme
Número Licitación : 1596-15-LP23

ORDEN DE COMPRA N°: 1596-146-SE23

SEÑOR (ES) : BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
RUT : 87.927.900-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 1 NORTE #711, TALCA. Talca Región del Maule
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : A convenir
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25101703	Ambulancias	1 Unidad	El Gobierno Regional del Maule, ubicado en 1 Norte N° 711, Talca, solicita adquirir una ambulancia para dar curso al Proyecto de "REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DEPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE", para la comuna de Villa Alegre.	AMBULANCIA PARA DEPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE	64.789.916,00	0,00	0,00	64.789.916
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	64.789.916
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	64.789.916
						19% IVA	\$	12.310.084
						Total	\$	77.100.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 933 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 933

Observaciones:

Adquisición Proyecto "REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE" COD. BIP. 40.026.686-0. COMPRA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
INCLUYE: Permiso Circulación, Placa Patente, SOAP, Rev. Técnica, Logos.
LUGAR DE ENTREGA: Dependencias I. Municipalidad de Villa Alegre, Plazo 01 día corrido

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(2592-2-PC23 / Sin Cod. Pres.)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



RESOLUCIÓN (E): N° 2816

MAT. : ADJUDICA E INSTRUYE EMITIR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.", Código BIP N° 40.026.686-0.

TALCA, 03 MAYO 2023

VISTOS:

- 1.- El artículo 111 de la Constitución Política del Estado, cuyo texto refundido, coordinado sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N°100 del 17 de Septiembre de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
- 2.- La Ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional;
- 3.- La Ley N° 21.516 de Presupuestos del sector Público para el año 2023;
- 4.- La Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento N° 250 aprobado por el Ministerio de Hacienda;
- 5.- La Resolución (E) N°6968 de fecha 14 de noviembre de 2022 del Gobierno Regional del Maule, que hace constar decisión de incorporar, para su financiamiento, al proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.", Código BIP N° 40.026.686-0;** por un monto de M\$114.240.-;
- 6.- La Resolución (E) N° 536 de fecha 26 de enero de 2023, del Gobierno Regional del Maule, la cual designa comisiones de evaluación y recepción;
- 7.- El Certificado N° 6/2023 de fecha 07 de febrero de 2023, de la profesional administradora de adquisiciones doña Lilian Figueroa Labraña, del Gobierno Regional del Maule, que certifica que el bien objeto de esta licitación no se encuentra en Convenio Marco;
- 8.- La Resolución (E) N° 981 de fecha 22 de febrero de 2023, del Gobierno Regional del Maule, que aprueba las Bases administrativas y Especificaciones Técnicas para licitar la adquisición del bien contemplado en el proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE", Código BIP N° 40.026.686-0;**
- 9.- La Licitación Pública ID 1596-15-LP23, publicada en el portal del Mercado Público con fecha 10 de marzo de 2023;
- 10.- La Resolución (A) N° 20 de fecha 11 de enero de 2023, de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que modifica el Presupuesto de los Gobierno Regionales, tomada de razón por parte de la Contraloría General de la República con fecha 27 de enero de 2023;
- 11.- La Resolución (E) N° 940 de fecha 21 de febrero de 2023, del Gobierno Regional del Maule, que crea asignación presupuestaria al proyecto objeto de la presente resolución. Conforme a esta Resolución, los recursos respectivos se encuentran identificados en el Presupuesto de inversión del Gobierno Regional del Maule;
- 12.- El Acta de Evaluación de las Ofertas, de fecha 11 de abril de 2023, suscrita por los integrantes de la Comisión de Evaluación de Antecedentes, creada mediante la Resolución (E) N° 536;
- 13.- El Memo N° 339 de fecha 27 de abril de 2023, de la Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, que instruye la dictación de la presente resolución;
- 14.- La Resolución (E) N° 940 de fecha 21 de febrero de 2023, del Gobierno Regional del Maule, que modifica el presupuesto de inversión del Gobierno Regional del Maule;

- 15.- Resolución TRA N° 809/14/2021 de fecha 06 de agosto de 2021, del Gobierno Regional del Maule, que nombra Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional, con toma de Toma de Razón por Parte de la Contraloría Regional del Maule, con fecha 19 de agosto del 2021;
- 16.- La Resolución (E) N° 1724 de fecha 04 de mayo de 2020, del Gobierno Regional del Maule; que delega facultades para suscribir documentos en Administrador Regional y en Jefes de División que indica y revoca resolución que señala;
- 17.- La Resolución (E) N° 3086 de fecha 07 de octubre de 2020, del Gobierno Regional del Maule, que modifica resolución (E) N°1724 de fecha 04 de mayo de 2020, del Gobierno Regional del Maule, sobre Delegación de Facultades en Administrador Regional y Jefes de División;
- 18.- La Resolución (E) N° 1736 de fecha 21 de abril de 2022, que complementa Resolución (E) N° 1724, de fecha 04 de mayo de 2020;
- 19.- La Resolución N° 7 y N° 8 de 2019 y N° 14 de 2022, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

El "Acta de Evaluación de las Ofertas y propuesta de adjudicación", de fecha 11 de abril de 2023 la cual se adjunta a la presente resolución, suscrita por los integrantes de la Comisión de Evaluación de Antecedentes, creada mediante Resolución (E) N° 536 de fecha 26 de enero de 2023, del Gobierno Regional del Maule, correspondiente al proyecto de inversión denominado **"REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE"**, Código BIP N° 40.026.686-0, cuyo texto a continuación se transcribe:

Infor. : _____/

Ant. : 1. Licitación Pública 1596-15-LP23

2. Resolución (E) N° 981 de fecha 22.02.2023, del Gobierno Regional del Maule, que aprueba Bases.

3. Resolución (E) N° 536 de fecha 26.01.2023, del Gobierno Regional del Maule, que nombra comisión.

Mat. : Informa y propone resultado de licitación de proyecto que indica.

Talca 11 de abril de 2023

A : CRISTINA BRAVO CASTRO
GOBERNADORA REGIONAL DEL MAULE

DE : COMISION EVALUADORA POR RESOLUCION (E): N° 536

Junto con saludarle, por medio de la presente esta comisión se dirige a usted para informar el resultado de la evaluación de las ofertas presentadas en la licitación del siguiente proyecto:

Código BIP	Nombre Proyecto
------------	-----------------



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL MAULE**

40.026.686	REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.
------------	--

Los integrantes de la presente comisión evaluadora dejan expresa constancia que: respecto de las personas naturales y/o jurídicas oferentes en esta Licitación, no tienen la calidad de cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, así como tampoco en su caso forman parte, ni se trata de una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada en que ellos sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que ellos sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital y, finalmente, que no tienen la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antes mencionadas; ni les afecta ninguna otra inhabilidad o impedimento legal para el desempeño de esta función.

Asimismo, dejan constancia de que adquieren un compromiso de confidencialidad respecto de las ofertas presentadas, la documentación producida y de todas las deliberaciones que se han llevado a cabo durante el proceso de evaluación de la presente licitación.

A.- OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN:

A.1.- Ingreso en Portal Mercadopublico.cl:

Se verificó la presentación de 06 oferentes y 06 ofertas en el portal Mercadopublico.cl, según detalle:

Código BIP	Nombre proyecto	Nombre oferente	RUT oferente
40.026.686	REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	87.927.900-3
		CONVERSIONES SAN JOSE SPA	96.981.470-6
		COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS LIMITADA	76.099.641-6
		COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA	76.319.948-7
		L.J. AUTOMOTRIZ LTDA.	76.092.123-8
		PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA	77.500.124-0

A.2.- Análisis de Antecedentes Administrativos de las Ofertas:

Con respecto a la presentación de los antecedentes administrativos de las ofertas se pudo observar lo siguiente:

Antecedentes Administrativos	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	CONVERSIONES SAN JOSE SPA	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS LIMITADA	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA	L.J. AUTOMOTRIZ LTDA.	PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA
-------------------------------------	---	---------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------	------------------------------

Anexo N° 1. Carla Presentación del Oferente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Anexo N° 2. Declaración Jurada Simple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Declaración Jurada Compromiso	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Declaración Jurada Servicio Técnico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Certificado Compromiso Capacitación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Anexo N° 3. Oferta Económica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Anexo N° 4. Oferta Técnica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple

- La empresa "PUCICTRAIL INVESTMENT LTDA" no presenta todos los antecedentes administrativos solicitados según lo señalado en el punto N° 8, de las bases administrativas de la presente licitación con respecto a la "Forma de Presentación de las Ofertas", se dice que "La no presentación de alguno de los documentos y Anexos señalados precedentemente tendrá como consecuencia que la oferta no será evaluada.", por lo que sus ofertas no serán evaluadas.

A.3.- Análisis de Antecedentes Técnicos de la Oferta:

Con respecto a la revisión del cumplimiento de los antecedentes técnicos de las ofertas, según lo señalado en el Anexo N° 4 y documentos adicionales presentados en las respectivas ofertas, se puede informar lo siguiente:

		BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	CONVERSIONES SAN JOSE SPA	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS LIMITADA	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA	L.J. AUTOMOTRIZ LTDA.
Ambulancia		Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5
1.- MOTOR CATALÍTICO	SOLICITADO					
Combustible	Diésel (Petróleo)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tracción	4x2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema de inyección	Inyección Directa Common Rail (CDI)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de motor	4 cilindros con turbo e intercooler	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cilindrada	2.000 cc como mínimo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Potencia	150 hp o superior a 3800 rpm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Torque mínimo	330 N a 1200 - 2400 rpm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tanque de combustible (capacidad)	70 litros o superior.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Rendimiento aproximado	8 kilómetros por litro	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Normas de emisión	Euro V o superior	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Filtrado de combustible	2 filtros (1 decantador de agua)	Cumple	Cumple	Cumple		Cumple
Controlador de tiempo de funcionamiento del motor	Horómetro Incorporado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
GPS	Sistema de Monitoreo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.- SISTEMA ELECTRICO	SOLICITADO					
Tipo de encendido.	Convencional.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Voltaje Sistema Eléctrico.	12 volts.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Batería para toda la	Doble y/o Servicio	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL MAULE**

demanda eléctrica del Vehículo.	pesado, 12 volt / 100 ah				(90 Ah)	
Capacidad Batería Sistema.	5 ah por sobre Equipo original.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema Eléctrico. -	Con alternador y adecuado a la demanda del Sistema. 14 volt / 180 ah	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica alternador y adecuado a la demanda del Sistema. 180 ah)	Cumple
Focos neblineros.	Dos focos Halógenos con haz cortan niebla en posición frontal, protegidos y controlados desde cabina de conducción.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica si focos son halógenos y protegidos)	No Cumple (No indica Dos focos Halógenos con haz cortan niebla en posición frontal, protegidos y controlados desde cabina de conducción)	No Cumple (No indica si focos son halógenos y protegidos)
Foco Busca caminos.	Portátil, 12 volts. Al lado del Chofer.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica si foco es portátil)	No Cumple (No indica portátil, al lado del chofer)	No Cumple (No indica si foco es portátil)
Foco auxiliar trasero (faenero).	Un foco, con comando desde la cabina del conductor. Indicar su capacidad en Watts. Ubicado en la parte trasera exterior en posición alta	Cumple (27 Watts)	Cumple (55 Watts)	Cumple (50 watts)	No Cumple (No indica comando desde la cabina del conductor. Indicar su capacidad en Watts.)	Cumple (50 watts)
Luces de retroceso, estacionamiento, emergencia. - Indicadores viraje y luz de cortesía de cabina.	De fabricación. Originales del Vehículo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Luces de Alta Intensidad	En la célula Sanitaria, 4 o más focos LED, de alta y baja intensidad. Dos focos direccionales sobre la cabeza y tronco del paciente. Comandos en cabina sanitaria.	Cumple	Cumple	No Cumple (indica luces direccionales ubicados en la cabeza y el tronco)	No Cumple (No indica en la célula Sanitaria, 4 o más focos LED, de alta y baja intensidad. Dos focos direccionales sobre la cabeza y tronco del paciente. Comandos en cabina sanitaria)	No Cumple (indica luces direccionales ubicados en la cabeza y el tronco)
Luces Perimetrales con focos halógenos. Comando en cabina de conducción. -	Sistema LED, con destelladores. Dos Blancos de escena en Sector Lateral central. Cuatro focos Rojo-Azul Sistema LED Intermitentes Secuenciales, dos por cada lateral Superior y dos en parte trasera superior. Certificar que componentes son de 1º nivel, (ideal americano)	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica destelladores. Dos Blancos de escena en Sector Lateral central. Cuatro focos Rojo-Azul Intermitentes Secuenciales, dos por cada lateral Superior y dos en parte trasera superior. Certificar que componentes son de 1º nivel, (ideal americano))	Cumple
Luces de posición reglamentarias	Luces de posición reglamentarias: Dos focos LED alta intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal. Tercera luz de freno.	Cumple	Cumple	No cumple (no indica cantidad focos LED alta intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal. Tercera luz de freno.)	No Cumple (No indica Luces de posición reglamentarias: Dos focos LED alta intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal.)	No cumple (no indica cantidad focos LED alta intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal.)

					frontal. Tercera luz de freno)	Tercera luz de freno.)
Sirena de Alerta multitonar.	Una, Multitonar (cuatro tonos), con sistema de alta voz, 100 watts, de reconocida calidad. -	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Multitonar (cuatro tonos), con sistema de alta voz)	Cumple
Balizas intermitentes y/o destellantes, ubicadas en el techo.	Un barral frontal con sistema LED, color rojo / azul, 12 Volts. Montada sobre base aerodinámica plástica tipo PRFV. En la carrocería del vehículo.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener 12 Volts y ser de plástico tipo PRFV)	No Cumple (No indica Un barral frontal, color rojo / azul, 12 Volts. Montada sobre base aerodinámica plástica tipo PRFV. En la carrocería del vehículo)	No Cumple (No indica tener 12 Volts y ser de plástico tipo PRFV)
Balizas traseras	Dos focos LED alta intensidad rojo/azul en zona superior de puertas traseras.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica dos focos rojos/azul en zona superior de puertas traseras)	Cumple
Limpia y lava Parabrisas Eléctrico.	De fabricación. Originales del Vehículo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Alarma de retroceso	De fábrica.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN	SOLICITADO					
Caja de cambios	Mecánica de 6 velocidades hacia adelante y 1 atrás	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tracción	Trasera (4x2 o 4x4)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Dirección	Asistida	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4.- CHASSIS Y PESOS	SOLICITADO					
Tipo de Chasis	Tipo Escalera	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Peso Bruto Vehicular	3.800 kgs. Aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de carga	1.500 kgs. Aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Llantas	De acero aro 16	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5.- CARROCERÍA Y DIMENSIONES	SOLICITADO					
Tipo de Carrocería	Furgón techo alto de fábrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Material	Acero reforzado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parachoques trasero	De acceso con superficie antideslizante	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica acceso con superficie antideslizante)	Cumple
Largo total exterior	5.500 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ancho total exterior sin espejos	1.900 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Alto total exterior	2.500 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Largo interior zona de célula sanitaria	3.000 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ancho interior	1.700 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Alto interior	1.800 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Volumen zona de cápsula sanitaria	10,5 mts. ² aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parabrisas	Blindado con lamina interior, Todos los vidrios cabina conducción más ventana módulo sanitario y vidrios puertas traseras	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Blindado con lamina interior, Todos los vidrios cabina conducción más ventana módulo sanitario y vidrios puertas traseras)	Cumple
6.- CABINA	SOLICITADO					
Puertas.	2 puertas, Ambulancia.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Espejos exteriores.	Izquierdo y derecho grandes.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tablero con indicadores de alarma y lectura, comandos	Consola que integre interruptores eléctricos, sirena electrónica, y	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica respecto a	Cumple



de sirena, balizas y neblineros.	espacio para transductor radial, ubicada en la parte central superior del panel de instrumentos del vehículo, que facilite el manejo tanto por parte del conductor como del copiloto. En lo posible integrada al tablero de todos los sistemas vitales, Balizas, Foco faenero, Neblineros y radiocomunicaciones.				Interruptores eléctricos, sirena electrónica, y espacio para transductor radial, ubicada en la parte central superior del panel de instrumentos del vehículo, que facilite el manejo tanto por parte del conductor como del copiloto. En lo posible integrada al tablero de todos los sistemas vitales, Balizas, Foco faenero, Neblineros y radiocomunicación)	
Comando de luz, calefacción y ventilación.	De la Célula Sanitaria.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de pasajeros.	Dos, Incluye conductor.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Calefacción, aire fresco y desempañador, viseras contra el sol (izquierda y derecha).	Como standard. equipo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema Radiocomunicación	Base de vehículo, dos portátiles y parlante con micrófono en cabina sanitaria (PTT).	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Base de vehículo, dos portátiles y parlante con micrófono en cabina sanitaria (PTT))	Cumple
Asientos.	2 tipo Butaca.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser tipo butaca)	Cumple
Tapiz.	Tapiz Automotriz.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener Tapiz automotriz)	Cumple
Extintores de incendio	Adosado en posición vertical en interior de la cabina. Capacidad de acuerdo a Norma (2 kilos).	Cumple	Cumple	No cumple (No indica estar Adosado en posición vertical en interior de la cabina)	No Cumple (No indica estar Adosado en posición vertical en interior de la cabina. Capacidad de acuerdo a Norma (2 kilos)).	No cumple (No indica estar Adosado en posición vertical en interior de la cabina)
Cinturones de seguridad.	Proporcional al número de pasajeros.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7.- SISTEMA DE FRENOS	SOLICITADO					
De Servicio	De doble circuito con servo-depresión y de disco en las 4 ruedas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser de doble circuito con servo-depresión y de disco en las 4 ruedas)	Cumple
Sistemas de eficiencia de frenado	ESP: Control de estabilidad con: ABS: Antibloqueo de frenos ASR: Control de Tracción BAS: Servofreno de emergencia EBV: Distribución electrónica de fuerza	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

	de frenado					
Airbag	Para el conductor y copiloto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
De Estacionamiento	Accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica si estacionamiento es por accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras)	No Cumple (No indica tener accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras)	No Cumple (No indica si estacionamiento es por accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras)
8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN	SOLICITADO					
Suspensión Delantera/ Trasera	Debe ser adecuada para traslado sanitario, especialmente poli traumatizado, debe ser blanda, con el mínimo de vibración	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser adecuada para traslado sanitario, especialmente poli traumatizado, debe ser blanda, con el mínimo de vibración)	Cumple
Suspensión Delantera	Independiente; eje delantero de conjuntos telescópicos con ballesta transversal parabólica y estabilizador.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Suspensión Trasera	Eje trasero rígido, con suspensión de ballesta trasera.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Amortiguadores	2 delanteros y 2 traseros hidráulicos de doble efecto	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica 2 delanteros y 2 traseros hidráulicos de doble efecto)	Cumple
Barra estabilizadora	Delantera y trasera	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Delantera y trasera)	Cumple
9.- CÉLULA SANITARIA	SOLICITADO					
Dimensiones	Largo 3.000 mm. Aprox. (+/- 500 mm) Alto 1.800 mm. Aprox. (+/- 200 mm) Ancho 1.700 mm. Aprox. (+/- 300mm)	Cumple*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ventana de Intercomunicación	Ventana automatiz de apertura horizontal que permita comunicación desde cabina de conducción hacia cabina sanitaria.	Cumple*	Cumple	No Cumple (Ventana de apertura vertical)	No Cumple (No indica Ventana automatiz de apertura horizontal que permita comunicación desde cabina de conducción hacia cabina sanitaria)	No Cumple (Ventana de apertura vertical)
Puertas N° y ubicación.	1 Puerta lateral.	Cumple*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de pasajeros.	Mínimo, 4 Incluyendo al paciente.	Cumple*	Cumple	Cumple	No cumple (3 pasajeros)	Cumple
Portón trasero.	Dos puertas de batiente, con anclaje lateral de seguridad, cada una con vidrio fijo y pavadado autoadhesivo. Incluir pisadera original de fábrica con	Cumple*	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener dos puertas de batiente, con anclaje lateral de seguridad, cada una con vidrio fijo y	Cumple



	superficie antideslizante.				pavonado autoadhesivo. Incluir pisadera original de fábrica con superficie antideslizante)	
Asiento paramédico.	<p>Butaca Ergonómica con apoya cabeza. Cajinería de poliuretano inyectado, tapizada en cuero sintético, resistente al roce, humedad, fluidos y de fácil limpieza. Instalada a la cabecera de la camilla sobre estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y respaldo con apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera mínimo 3 posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Cinturón de seguridad de 3 puntas con dispositivo retráctil automático para facilitar la movilidad del interventor. Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible. Debe incluir un cinturón de seguridad de 3 puntas retráctil y autoajustable.</p>	Cumple*	Cumple	<p>No Cumple (No indica una Butaca Ergonómica con apoyacabeza. Cajinería de poliuretano inyectado. Instalada a la cabecera de la camilla sobre estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y respaldo con apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera mínimo 3 posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible. Debe incluir un cinturón de seguridad de 3 puntas retráctil y autoajustable)</p>	<p>No Cumple (No indica una butaca Ergonómica con apoyacabeza. Cajinería de poliuretano inyectado, tapizada en cuero sintético, resistente al roce, humedad, fluidos y de fácil limpieza. Instalada a la cabecera de la camilla sobre estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y respaldo con apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera mínimo 3 posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Cinturón de seguridad de 3 puntas con dispositivo retráctil automático para facilitar la movilidad del interventor. Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible. Debe incluir un cinturón de seguridad de 3 puntas retráctil y autoajustable)</p>	<p>No Cumple (No indica una Butaca Ergonómica con apoyacabeza. Cajinería de poliuretano inyectado. Instalada a la cabecera de la camilla sobre estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y respaldo con apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera mínimo 3 posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible. Debe incluir un cinturón de seguridad de 3 puntas retráctil y autoajustable)</p>
Piso.	Terclado marino de mínimo 10 mm. de espesor.	Cumple*	Cumple	No Cumple (no indica sobrepasar en el	No Cumple (No indica ser Terclado marino	No Cumple (no indica sobrepasar en

	<p>revestimiento debe ser plano, continuo, sin juntas ni uniones, de alto tráfico, lavable e impermeable, de vinilo de excelencia (tipo tarkett o equivalente). Debe sobrepasar en al menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble. Piso debe estar reforzado con plancha de acero inoxidable en zonas de alto tráfico: Acceso trasero y lateral. Debe tener evacuación controlada para eliminación de desechos biológicos durante el aseo.</p>			<p>menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble)</p>	<p>de mínimo 10 mm, de espesor. El revestimiento debe ser plano, continuo, sin juntas ni uniones e impermeable. Debe sobrepasar en al menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble. Piso debe estar reforzado con plancha de acero inoxidable en zonas de alto tráfico: Acceso trasero y lateral. Debe tener evacuación controlada para eliminación de desechos biológicos durante el aseo)</p>	<p>al menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble)</p>
<p>Paredes laterales y techo.</p>	<p>Interior área paciente (Revestimiento interior). Paredes completas y cielo en material lavable, que no acumule residuos, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado (sello perimetral). En fibra de vidrio. Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente). Debe instalarse entre carrocería y paneles interiores de la cabina sanitaria.</p>	<p>Cumple*</p>	<p>Cumple</p>	<p>No Cumple (No indica respecto a Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente))</p>	<p>No Cumple No indica paredes completas y cielo en material lavable, que no acumule residuos, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado (sello perimetral). En fibra de vidrio. Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente). Debe instalarse entre carrocería y paneles interiores de la cabina sanitaria)</p>	<p>No Cumple (No indica respecto a Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente))</p>
<p>Portasueros.</p>	<p>Sistema de aluminio, instalado en el cielo de la cabina sanitaria compuesto por : Dos (2) soportes para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo</p>	<p>Cumple*</p>	<p>Cumple</p>	<p>No Cumple (no indica tener para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo)</p>	<p>No Cumple (No indica ser un Sistema de aluminio, compuesto por : Dos (2) soportes para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo)</p>	<p>No Cumple (no indica tener para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo)</p>
<p>Barras de Soporte y Pasamanos.</p>	<p>Una (1) barra vertical de soporte de equipos con al menos tres apoyos, fijada en zona estructural del móvil. Un (1) pasamanos</p>	<p>Cumple</p>	<p>Cumple</p>	<p>No Cumple (No indica respecto a barra vertical de soporte de equipos con al</p>	<p>No indica tener Una (1) barra vertical de soporte de equipos con al menos tres</p>	<p>No Cumple (No indica respecto a barra vertical de soporte de equipos con al</p>



	<p>metálico fabricado en aluminio, instalado en cielo de módulo sanitario dispuesto de forma ergonómica.</p> <p>Un (1) pasamanos metálico fabricado en aluminio, para fácil acceso por puerta lateral.</p> <p>Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero</p> <p>Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la camilla. Debe existir otro adosado a las gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla.</p>			<p>menos tres apoyos y tener Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero</p> <p>Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la camilla. Debe existir otro adosado a las gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla)</p>	<p>apoyos, fijada en zona estructural del móvil.</p> <p>Un (1) pasamanos metálico fabricado en aluminio, instalado en cielo de módulo sanitario dispuesto de forma ergonómica.</p> <p>Un (1) pasamanos metálico fabricado en aluminio, para fácil acceso por puerta lateral.</p> <p>Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero</p> <p>Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la camilla. Debe existir otro adosado a las gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla)</p>	<p>menos tres apoyos y tener Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero</p> <p>Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la camilla. Debe existir otro adosado a las gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla)</p>
Asiento longitudinal	<p>Estructurado en acero y fibra de vidrio, para tres personas, cubierta acolchada y tapizada y respaldo de apoyo.</p> <p>Estar ubicado al costado derecho del área del paciente.</p> <p>Remate al piso curvo para continuarse con recubrimiento de piso.</p> <p>Cinturones de seguridad de tres puntas.</p> <p>Deberá considerar tres cinturones de seguridad de 3 puntas, retráctil, considerando la mayor fijación del usuario en el sentido de desplazamiento del vehículo.</p> <p>Amplio compartimiento para almacenaje de equipos. Con acceso desde tapa superior.</p> <p>Nicho para el transporte de Equipos o insumos menores.</p> <p>Incorporar espacios para recipiente desechos generales y materiales cortopunzantes.</p>	Cumple	Cumple	Cumple	<p>No Cumple (No indica estar Estructurado en acero y fibra de vidrio, para tres personas, cubierta acolchada y tapizada y respaldo de apoyo. Estar ubicado al costado derecho del área del paciente.</p> <p>Remate al piso curvo para continuarse con recubrimiento de piso.</p> <p>Cinturones de seguridad de tres puntas.</p> <p>Deberá considerar tres cinturones de seguridad de 3 puntas, retráctil, considerando la mayor fijación del usuario en el sentido de desplazamiento del vehículo.</p> <p>Amplio compartimiento para almacenaje de</p>	Cumple

					equipos. Con acceso desde tapa superior, Nicho para el transporte de Equipos o insumos menores)	
Dispositivo transporte segundo paciente:	Dispositivo desarrollado para transportar tabla espinal con un segundo paciente dispuesto en el asiento longitudinal, sujeto por un cinturón de seguridad.	Cumple	No Cumple (Dispuesto en zona baja de mueble anaquel médico)	Cumple	No Cumple (No indica Dispositivo desarrollado para transportar tabla espinal con un segundo paciente, sujeto por un cinturón de seguridad)	Cumple
Ventilación.	Extractor de aire eléctrico, centrífugo de gran caudal, ubicado en el techo de la cabina sanitaria, lejos de la cabeza del paciente.	Cumple	Cumple	No cumple (No indica que ubicación está lejos de la cabeza del paciente)	No Cumple (No indica tener un Extractor de aire eléctrico, centrífugo de gran caudal, ubicado en el techo de la cabina sanitaria, lejos de la cabeza del paciente)	No cumple (No indica que ubicación está lejos de la cabeza del paciente)
Ventilador para el paciente.	Eléctrico 12 Volts	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Vidrios de seguridad.	Con vidrio blanco o esmerilado en paredes laterales. (Ventana corredera).	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener vidrio blanco o esmerilado en paredes laterales. (Ventana de corredera)	Cumple
Calefacción	Independiente, por circuito cerrado de agua caliente, dos velocidades y comando en cabina sanitaria, salida del aire en la parte inferior del mueble sanitario, lejos de la cabeza del paciente.	Cumple	Cumple	No cumple (No indica estar comando en cabina sanitaria, salida del aire en la parte inferior del mueble sanitario, lejos de la cabeza del paciente)	No Cumple (No indica ser independiente, por circuito cerrado de agua caliente, dos velocidades y comando en cabina sanitaria, salida del aire en la parte inferior del mueble sanitario, lejos de la cabeza del paciente)	No cumple (No indica estar comando en cabina sanitaria, salida del aire en la parte inferior del mueble sanitario, lejos de la cabeza del paciente)
Red Eléctrica	220 volts. Instalada en compartimiento sanitario, con 4 enchufes hembras convencionales para equipos médicos.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica estar instalada en compartimiento sanitario, con 4 enchufes hembras convencionales para equipos médicos)	Cumple
Compartimiento paciente y cabina chofer.	Panel divisorio de cabina y área paciente; No considera vano de paso. Fijación superior e inferior. Deberá contar con ventana de comunicación entre la cabina sanitaria y de conducción con cierre con vidrio o similar pavorado. Panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado).	No Cumple (No indica tener un panel divisorio de cabina y área paciente; No considera vano de paso. Fijación superior e inferior. Deberá contar con ventana de comunicación entre la cabina sanitaria y de	No Cumple (No indica panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado).



	debidamente sellado.				conducción con cierre con vidrio o similar pavonado. Panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado)	
10.- EQUIPAMIENTO CÉLULA SANITARIA	SOLICITADO					
Camilla.	Patas altas retráctiles, operable por una persona, capacidad 250 Kgs. Construida en duraluminio tubular, seis ruedas, dos rotatorias. Respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Debe tener sistema Trendelenburg y Sisma anclaje alta seguridad 10G. Colchoneta de material lavable, antiséptico y resistente. Dispositivo de anclaje, sujeción al piso y manilla desenganche rápido, barandas laterales abatibles y cinturones de seguridad. Anclaje compatible para traslado de incubadora de transporte. Ruedas de 200 mm de diámetro	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener seis ruedas, dos rotatorias. Respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Debe tener sistema Trendelenburg)	No Cumple (No indica tener patas altas retráctiles, operable por una persona, construida en duraluminio tubular, respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Colchoneta de material lavable, antiséptico y resistente. Dispositivo de anclaje, sujeción al piso y manilla desenganche rápido, barandas laterales abatibles. Anclaje compatible para traslado de incubadora de transporte. Ruedas de 200 mm de diámetro)	No Cumple (No indica tener seis ruedas, dos rotatorias. Respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Debe tener sistema Trendelenburg)
Camilla Portátil	Enrollable, cubierta resistente y lavable. Asas de transporte.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener Asas de transporte)	No Cumple (No indica tener cubierta resistente y lavable. Asas de transporte)	No Cumple (No indica tener Asas de transporte)
Silla de Ruedas Plegable	Silla de ruedas plegable, con dispositivo que permita su fijación en cabina sanitaria.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Equipo Oxigenoterapia Portátil.	*Soporte de sujeción de aluminio para camilla. *01 cilindro tipo D (con Carga) *Regulador con flujometro tipo PIN INDEX, humidificador y válvula.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener *Soporte de sujeción de aluminio para camilla. *01 cilindro tipo D (con Carga) *Regulador con flujometro tipo PIN INDEX, humidificador y válvula)	Cumple
Red Oxígeno Central	Red de Oxígeno de alta presión con regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada en mueble médico, debe incluir regulador, flujómetro y humidificador. - 01 cilindro de Oxígeno	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de	No Cumple (No indica tener Red de Oxígeno de alta presión con regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada	No Cumple (No indica válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble

	9 mts. ³ , válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad.			visibilidad)	en mueble médico, debe incluir regulador, flujómetro y humidificador. - 01 cilindro de Oxígeno 9 mts. ³ , válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad)	modular, con ventanilla de visibilidad)
Anclaje y carro porta cilindro de oxígeno	Anclaje metálico para cilindro de oxígeno de 9 mts. ³ , ubicado en zona de máxima seguridad entre cabina de conducción y compartimento sanitario fijo al piso, atrás del panel divisorio y transversal al vehículo. Incluye carro desmontable desde su anclaje junto al cilindro, permitiendo el traslado de éste y una operación de recambio segura y sin esfuerzos.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener anclaje metálico para cilindro de oxígeno de 9 mts. ³ , ubicado en zona de máxima seguridad entre cabina de conducción y compartimento sanitario fijo al piso, atrás del panel divisorio y transversal al vehículo. Incluye carro desmontable desde su anclaje junto al cilindro, permitiendo el traslado de éste y una operación de recambio segura y sin esfuerzos)	Cumple
Mueble anaquel Médico	Mueble Lateral izquierdo, construido de piso a cielo, de todo el ancho del vehículo. Debe ser construido en material que permita su lavado o limpieza profunda. Debe contar sistema de almacenaje de fácil acceso para los usuarios, incluso en movimiento, con habitáculos con puertas de material transparente deslizable vertical u horizontalmente y divisiones interiores para almacenar insumos médicos. Indicar el número de habitáculos disponibles. El Sistema de almacenaje debe ser de material lavable y permitir una limpieza profunda, con bordes que eviten la caída de objetos, rotulable, resistente al Impacto. Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abatir que permita posiciones para cierre completo y	Cumple	Cumple*	No Cumple (No indica Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abatir que permita posiciones para cierre completo y ventilación. Debe tener a lo menos dos bandejas (2) ajustables)	No Cumple (No indica Mueble Lateral izquierdo, construido de piso a cielo, de todo el ancho del vehículo. Debe ser construido en material que permita su lavado o limpieza profunda. Debe contar sistema de almacenaje de fácil acceso para los usuarios, incluso en movimiento, con habitáculos con puertas de material transparente deslizable vertical u horizontalmente y divisiones interiores para almacenar insumos médicos, Indicar el número de	No Cumple (No indica Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abatir que permita posiciones para cierre completo y ventilación. Debe tener a lo menos dos bandejas (2) ajustables)



	<p>ventilación. Debe tener a lo menos dos bandejas (2) ajustables. Debe tener una cubierta de trabajo al lado del asiento del paramédico, con bordes redondeados, con barandas en todo el frente para evitar la caída de objetos. En su parte superior debe incorporar paneles independientes uno para controles generales y otro para puestos de toma oxígeno y vacío.</p>				<p>habitáculos disponibles. El Sistema de almacenaje debe ser de material lavable y permitir una limpieza profunda, con bordes que eviten la caída de objetos, rotulable, resistente al impacto. Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abalir que permita posiciones para cierre completo y ventilación. Debe tener a lo menos dos bandejas (2) ajustables. Debe tener una cubierta de trabajo al lado del asiento del paramédico, con bordes redondeados, con barandas en todo el frente para evitar la caída de objetos. En su parte superior debe incorporar paneles independientes uno para controles generales y otro para puestos de toma oxígeno y vacío)</p>	
Mueble modular	<p>Fabricado en material lavable, ubicado en la división de las cabinas de conducción y sanitaria. Con divisiones para guardar 2 bolsos de reanimación. Provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio.</p>	Cumple	Cumple	<p>No Cumple (No indica estar provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio)</p>	<p>No Cumple (No indica ser fabricado en material lavable, ubicado en la división de las cabinas de conducción y sanitaria. Con divisiones para guardar 2 bolsos de reanimación. Provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio)</p>	<p>No Cumple (No indica estar provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio)</p>

Kit de Férulas	Semirígidas, para extremidades fracturadas con fijación con velcro. Adulto y pediátrico 5 Unidades para brazos y piernas con bolso de transporte.	Cumple	Cumple	No Cumple (no indica férulas Adulto y pediátrico)	movimiento para recambio) No Cumple (No indica ser Semirígidas, para extremidades fracturadas con fijación con velcro. Adulto y pediátrico 5 unidades para brazos y piernas con bolso de transporte)	No Cumple (no indica férulas Adulto y pediátrico)
Inmovilizador de Cabeza	01 Unidades Universales de cabeza, con cojines laterales perforados	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica 01 Unidades Universales de cabeza, con cojines laterales perforados)	Cumple
Kit Tablas de Espinales	Un largo adulto de material plástico resistente, radio lúcida capacidad de 250 kg. Orificios necesarios para instalar correas para Inmovilizar (3 incorporadas) y base de inmovilizador de cabeza. Una Corta de extricación y una para uso pediátrico, fabricadas en plástico resistente, lavable. Con correas de seguridad para cada tabla y anclaje de traslado.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Un largo adulto de material plástico resistente, radio lúcida capacidad de 250 kg. Orificios necesarios para instalar correas para Inmovilizar (3 incorporadas) y base de inmovilizador de cabeza. Una Corta de extricación y una para uso pediátrico, fabricadas en plástico resistente, lavable. Con correas de seguridad para cada tabla y anclaje de traslado)	Cumple
Kit Collares Cervicales	6 unidades regulables de 4 posiciones, 3 Adulto y 3 Pediátrico.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser regulables de 4 posiciones)	Cumple
Kit Resucitadores Manuales	Autoclavables, medidas adultas, pediátricas. Fabricado en silicona, válvula de seguridad. Entrada lateral para Oxígeno. Con bolsa reservorio y mascarilla, válvulas de PEEP desmontables	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica estar fabricado en silicona)	No Cumple (No indica ser Autoclavables, Fabricado en silicona, válvula de seguridad. Entrada lateral para Oxígeno. Con bolsa reservorio y mascarilla, válvulas de PEEP desmontables)	No Cumple (No indica estar fabricado en silicona)
Esfigmomanómetro	Dos Tipo reloj anerode portátil resistente a golpes.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser de dos Tipo reloj anerode portátil resistente a golpes)	Cumple
Fonendoscopio Adulto y Neonatal (1 cada uno)	Doble cápsula	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Set Sábanas y frazadas	De Una Plaza, Dos Sábanas, dos frazadas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (Falta las	Cumple



	y dos sábanillas.				medidas y 02 sábanillas)	
Recipiente para desechos	Tres (3) recipientes para desechos, fabricados en aluminio electropintado, lavable, desinfectable, con señalética según corresponda, de 10 lts c/u anclado al compartimiento sanitario. - Contenedor N°1 color amarillo para residuos contaminados con fluidos de riesgo biológico. - Contenedor N°2 color negro para basura doméstica. - Contenedor N°3 blanco para ropa o utensilios contaminados; como bolsa máscara, hojas de laringoscopios hasta que puedan ser descontaminadas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Tres (3) recipientes para desechos, fabricados en aluminio electropintado, lavable, desinfectable, con señalética según corresponda, de 10 lts c/u anclado al compartimiento sanitario. Contenedor N°1 color amarillo para residuos contaminados con fluidos de riesgo biológico. Contenedor N°2 color negro para basura doméstica. Contenedor N°3 blanco para ropa o utensilios contaminados; como bolsa máscara, hojas de laringoscopios hasta que puedan ser descontaminadas)	Cumple
Dispensador desinfectante	Incluye dosificador, soporte y 02 carga	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica incluir dosificador, soporte y 02 carga)	Cumple
11.- SISTEMA ELÉCTRICO ÁREA PACIENTE	SOLICITADO					
Central de Comandos Eléctricos	Sistema Relé-fusible de alta capacidad, teclas con luz piloto y leyendas de identificación.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Sistema Relé-fusible de alta capacidad, teclas con luz piloto y leyendas de identificación)	Cumple
Panel Central de Comandos	Para equipos adicionales.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Toma corrientes 12 Volts 16 amps.	Tipo plug Dos unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Tipo plug)	Cumple
Batería Auxiliar	Batería de 100 Amp. De ciclo profundo (libre mantención) con puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga inversor	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga inversor)	No Cumple (No indica tener puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga inversor)	No Cumple (No indica puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga inversor)
12.- OTRAS CARACTERÍSTICAS	SOLICITADO					
Neumáticos.	6 Telas medida standard.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener 6 Telas medida standard)	Cumple

Rueda de repuesto.	Si. Acceso externo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Gata y llave de rueda.	De fabricación y además otras herramientas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Radio AM/FM - CD-USB	Si. Original de fábrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Pisos de goma en cabina conducción	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Kil de seguridad	Boliquín, triángulo y chaleco reflectante	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Gata y llave de rueda	Si, según Norma	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Incluir logo institucional "Gobierno Regional de Maule"	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Incluir logo Institucional	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos del vehículo al día	Permiso de circulación, seguro obligatorio, revisión técnica homologada, inscripción R.N.V.M, pago TAG o pase diario de traslado y Pago Impuesto verde si corresponde	Cumple	Cumple	Cumple		Cumple
Estanque de combustible lleno	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Manual del uso en español	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacitación	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Lugar Entrega del Vehículo	Villa Alegre (A confirmar dirección al momento de la entrega)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13.- CARACTERÍSTICAS SISTEMA RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL.	SOLICITADO					
01 SISTEMA MÓVIL	<ul style="list-style-type: none"> Transceptor Base Digital (32 Canales).- Antena Móvil, similar a ¼ de onda por altura. Instalación y Programación de Frecuencia.- 	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Transceptor Base Digital (32 Canales). Antena Móvil, similar a ¼ de onda por altura. Instalación y Programación de Frecuencia)	Cumple
01 TRANSCPTOR PORTÁTIL	<ul style="list-style-type: none"> 146 - 174 MHz, 16 canales, 5 Watts de potencia, scanner, que incluya Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa. 	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa)	No Cumple (No indica 146 - 174 MHz, 16 canales, 5 Watts de potencia, scanner, que incluya Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa)	No Cumple (No indica Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa)
01 KIT MICRÓFONO Y PARLANTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Instalado en cabina sanitaria en panel divisorio de contra cabina.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14.- OTRAS CARACTERÍSTICAS	SOLICITADO					
Red Eléctrica 220 Volts.	En compartimiento Sanitario, protegida por automático de 10 amp., tres enchufes hembras convencionales ,cable alargador 20 mls para 2.000 watts y toma corriente exterior con tapa de protección	Cumple	Cumple	Cumple (no indica amp)	No Cumple (No indica estar en compartimiento Sanitario, protegida por automático de 10 amp., tres enchufes hembras	Cumple



	para intemperie.-				convencionales -cable alargador 20 mts para 2.000 watts y toma corriente exterior con tapa de protección para intemperie)	
Inversor / Cargador de Corriente	2.000 watts. (Efectivo o medio) o superior de 12v a 220 Volts. (Que permita conversión de corriente para carga de equipos de radio portátil y equipos de uso frecuente como bombas de Infusión, entre otras.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No Indica ser superior de 12v a 220 Volts. (Que permita conversión de corriente para carga de equipos de radio portátil y equipos de uso frecuente como bombas de infusión, entre otras)	Cumple
Aire Acondicionado Frío-Frío.-	Sistema de aire acondicionado original de fábrica, de 12v, frío, doble, instalado en compartimiento sanitario y cabina conducción con comandos independientes. Delantero (Cabina) 7.000 BTU Trasero (sanitario) 23.000 BTU	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica respecto a Sistema de aire acondicionado original de fábrica, de 12v, frío, doble, instalado en compartimiento sanitario y cabina conducción con comandos independientes, Delantero (Cabina) 7.000 BTU Trasero (sanitario) 23.000 BTU)	Cumple	No Cumple (No indica respecto a Sistema de aire acondicionado original de fábrica, de 12v, frío, doble, instalado en compartimiento sanitario y cabina conducción con comandos independientes, Delantero (Cabina) 7.000 BTU Trasero (sanitario) 23.000 BTU)
Planos	Incluir planos y fotografías que permitan conocer claramente la distribución de muebles y equipos solicitados. Incluir diagrama eléctrico unifaseal del sistema eléctrico original y el adicional. Incluir memoria de cálculo del sistema de alimentación y distribución, además cálculo de secciones de cableado eléctrico.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Red Oxígeno Central	Red de Oxígeno de alta presión con regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada en mueble médico, debe incluir regulador, flujo metro y humidificador.-	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener una red de Oxígeno de alta presión con regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada en mueble médico, debe incluir regulador, flujo metro y humidificador)	Cumple
	01 cilindro de Oxígeno 9 mts. ³ , válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica 01 cilindro de Oxígeno 9 mts. ³ ,	Cumple

	facil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad.			válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad)
--	--	--	--	---

Cumple*: Posterior a consulta a través del foro inverso.

Observaciones:

- Las empresas "CONVERSIONES SAN JOSE SPA", "COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS MINEROS Y FLOTISTAS LTDA"., "COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA" Y L.J. AUTOMOTRIZ LTDA. no cumple con la totalidad de las características técnicas mínimas solicitadas, según lo indicado en cuadro precedente, considerándose su oferta inadmisibles y quedando excluida para continuar en evaluación, según lo estipulado en el punto N° 14.2.1 párrafo 2, en donde se dice que "A aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas serán excluidas de la evaluación".

B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará las ofertas conforme a los criterios y ponderaciones establecidos en las bases de licitación:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Plazo de Entrega	25 Puntos
Servicio Técnico Post Venta y Garantía	30 Puntos
Precio	40 Puntos
Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta	5 Puntos

a) Plazo de Entrega: 25 Puntos

Plazo de Entrega	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Oferta (s) con menor plazo de entrega (25 Puntos)	1 día
2º Oferta(s) con menor plazo de entrega (20 Puntos)	
3º Oferta(s) con menor plazo de entrega (15 Puntos)	
Resto de las ofertas (10 Puntos)	
PUNTAJE	25 puntos

b) Servicio Técnico de Post Venta y Garantía: 30 Puntos

Servicio Técnico de Post Venta 10 Puntos

Servicio Técnico de Post Venta	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Servicio Técnico Autorizado para los vehículos ofertado dentro de la Región del Maule (10 Puntos)	Servicio Técnico Autorizado para los vehículos ofertado dentro de la Región del Maule
Servicio Técnico Autorizado para los vehículos ofertado fuera de la Región del Maule (5 Puntos)	
PUNTAJE	10 puntos

Garantía 20 Puntos



Garantía		BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Superior a 24 meses.	(20 Puntos)	25 meses
Superior a 12 meses y hasta 24 meses.	(15 Puntos)	
Hasta 12 meses. Puntos)	(10	
PUNTAJE		20 puntos

c) Precio: 40 Puntos

Precio		BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
$I = (P \text{ min}/P) \times I \text{ máx.}$		\$ 77.100.000.-
Donde:		
I : Puntaje de la oferta, se expresará en dos decimales		
P mín : Precio de la oferta de menor costo		
P : Precio de la oferta en evaluación		
I máx : Puntaje máximo correspondiente a este criterio		
PUNTAJE		40 Puntos

d) Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta: 5 Puntos

Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta		BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Presentación total de los antecedentes solicitados sin errores u omisiones formales	(5 Puntos)	El oferente presenta los antecedentes omitidos en el plazo señalado en el foro inverso.
El oferente presenta los antecedentes omitidos en el plazo señalado en el foro inverso.	(3 Puntos)	
PUNTAJE		3 Puntos

PUNTAJES TOTALES

Criterio de Evaluación	Puntuación Máx.	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Plazo de Entrega	25 puntos	25 puntos
Servicio Técnico Post Venta y Garantía	30 puntos	30 puntos
Precio	40 puntos	40 puntos

Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta	5 puntos	3 puntos
PUNTAJE	100 puntos	98 puntos

C.- ANÁLISIS POSTERIOR DE LOS ANTECEDENTES:

Según lo establecido en la Res (E) N° 6968 de fecha 14 de noviembre del 2022, el presupuesto aprobado para el proyecto, con impuestos incluido, es el siguiente:

Código BIP	Nombre proyecto	Monto Aprobado \$
40.026.686	REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.	\$ 114.240.000.-

D.- SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN

Por todo lo antes expuesto y los antecedentes presentados, se sugiere salvo su mejor parecer, adjudicar la licitación pública ID 1596-15-LP23, al oferente que cumplió con todos los requisitos administrativos, técnicos y obtuvo el mayor puntaje ponderado, según los criterios de evaluación establecidos en las bases administrativas de esta licitación, correspondiente a la empresa: **BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA**, Rut **87.927.900-3**, por un valor de **\$ 77.100.000.- IVA incluido**, en un plazo de **01 día corrido**, contados desde la fecha de la Resolución que aprueba contrato.

Hay firma. **Diego Moraga Zuñiga** Comisión Evaluadora según Resolución (E) N° 536/2023. Profesional Unidad de Administración de Programas. Hay firma. **Oscar Pérez Ramos**. Comisión Evaluadora según Resolución (E) N° 536/2023. Profesional Unidad de Administración de Inversiones. Hay firma. **Rita Rojas Parra**. Comisión Evaluadora según Resolución (E) N° 536/2023. Profesional Unidad de Administración de Adquisiciones.

RESUELVO:

1.- ADJUDÍCASE, la Licitación Pública del proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE"**, Código BIP N° 40.026.686-0, en conformidad a su oferta, a la empresa **BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA**, Rut **87.927.900-3**, en un monto de **\$77.100.000.- IVA incluido**, en un plazo de **01 día corrido**, contados desde la fecha de la Resolución que aprueba contrato.

2.- INSTRÚYESE, emitir Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl, a través del procedimiento de Licitación Pública del Sistema de Compras y Contratación Pública, correspondiente al proyecto citado precedentemente, al oferente y en las condiciones señaladas a continuación:

PROYECTO	OFERENTE	RUT	COSTO EN \$ IVA INCLUIDO	PLAZO DE ENTREGA
----------	----------	-----	--------------------------	------------------

REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	87.927.900-3	\$77.100.000.-	01 día corrido
---	--	--------------	----------------	-------------------

3.- DÉJASE CONSTANCIA, de que la presente autorización, estará sujeta a la condición previa de que el bien ofrecido cumpla a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y demás anexos que contengan las bases de licitación del proyecto objeto de la presente resolución.

4.- ESTABLÉCESE, que el plazo de entrega es de 01 días corridos, contados desde la fecha de la resolución del Gobierno Regional del Maule que aprueba el contrato.

5.- IMPÚTESE, el gasto que demande la presente resolución al Programa 02 "Inversión Regional Región del Maule" del presupuesto del Gobierno Regional del Maule vigente, según el siguiente detalle:

Subtítulo	Ítem	Código BIP	Nombre del Proyecto	Monto \$ (IVA incluido)
29	03	40.026.686-0	REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE	\$77.100.000.-

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE.

"Por orden de la Gobernadora Regional del Maule"



Elena Fuyca Letelier
ELENA FUYCA LETELIER

**JEFA DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

**Delegación de Facultades por Resolución (E) N° UGD 1724 de 04.05.2020,
Resolución (E) N° 3086 de 07.10 2020 Y Resolución (E) N°1736 de 21.04.2022**

[Signature]
VGB

DISTRIBUCION:

- División de Presupuesto e Inversión Regional.
- Departamento de Gestión de Programas y Adquisiciones.
- Unidad de Administración de Adquisiciones.
- Unidad de Control.
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Oficina de Partes. U.G.D.



GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	
DIP	40.026.686
AUTORIZADO	MS 77.100.
COMPROMETIDO	MS -
SUBTÍTULO	29
ITEM	03
ASIGNACION	114 77.100
DOCUMENTOS	MS 77.100
SALDO	MS -
DEPARTAMENTO DE PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO	



Infor. : _____/

Ant. : 1. Licitación Pública 1596-15-LP23

2. Resolución (E) N° 981 de fecha 22.02.2023, del Gobierno Regional del Maule, que aprueba Bases.

3. Resolución (E) N° 536 de fecha 26.01.2023, del Gobierno Regional del Maule, que nombra comisión.

Mat. : Informa y propone resultado de licitación de proyecto que indica.

Talca 11 de abril de 2023

A : **CRISTINA BRAVO CASTRO**
GOBERNADORA REGIONAL DEL MAULE

DE : **COMISION EVALUADORA POR RESOLUCION (E): N° 536**

Junto con saludarle, por medio de la presente esta comisión se dirige a usted para informar el resultado de la evaluación de las ofertas presentadas en la licitación del siguiente proyecto:

Código BIP	Nombre Proyecto
40.026.686	REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.

Los integrantes de la presente comisión evaluadora dejan expresa constancia que: respecto de las personas naturales y/o jurídicas oferentes en esta Licitación, no tienen la calidad de cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, así como tampoco en su caso forman parte, ni se trata de una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada en que ellos sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que ellos sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital y, finalmente, que no tienen la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antes mencionadas; ni les afecta ninguna otra inhabilidad o impedimento legal para el desempeño de esta función.

Asimismo, dejan constancia de que adquieren un compromiso de confidencialidad respecto de las ofertas presentadas, la documentación producida y de todas las deliberaciones que se han llevado a cabo durante el proceso de evaluación de la presente licitación.

A.- OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN:

A.1.- Ingreso en Portal Mercadopublico.cl:

Se verificó la presentación de 06 oferentes y 06 ofertas en el portal Mercadopublico.cl, según detalle:

Código BIP	Nombre proyecto	Nombre oferente	RUT oferente
40.026.686	REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	87.927.900-3
		CONVERSIONES SAN JOSE SPA	96.981.470-6
		COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS LIMITADA	76.099.641-6
		COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA	76.319.948-7
		L.J. AUTOMOTRIZ LTDA.	76.092.123-8
		PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA	77.500.124-0

A.2.- Análisis de Antecedentes Administrativos de las Ofertas:

Con respecto a la presentación de los antecedentes administrativos de las ofertas se pudo observar lo siguiente:

Antecedentes Administrativos	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	CONVERSIONES SAN JOSE SPA	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS LIMITADA	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA	L.J. AUTOMOTRIZ LTDA.	PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA
Anexo N° 1. Carta Presentación del Oferente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Anexo N° 2. Declaración Jurada Simple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Declaración Jurada Compromiso	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Declaración Jurada Servicio Técnico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Certificado Compromiso Capacitación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Anexo N° 3. Oferta Económica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Anexo N° 4. Oferta Técnica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple

- La empresa "PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA" no presenta todos los antecedentes administrativos solicitados según lo señalado en el punto N° 8, de las bases administrativas de la presente licitación con respecto a la "Forma de Presentación de las Ofertas", se dice que "La no presentación de alguno de los documentos y Anexos señalados precedentemente tendrá como consecuencia que la oferta no será evaluada.", por lo que sus ofertas no serán evaluadas.



A.3.- Análisis de Antecedentes Técnicos de la Oferta:

Con respecto a la revisión del cumplimiento de los antecedentes técnicos de las ofertas, según lo señalado en el Anexo N° 4 y documentos adicionales presentados en las respectivas ofertas, se puede informar lo siguiente:

		BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA	CONVERSIONES SAN JOSE SPA	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS LIMITADA	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA	L.J. AUTOMOTRIZ LTDA.
Ambulancia		Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5	Sprinter 416 Cdl. 10.5
1.-MOTOR CATALITICO	SOLICITADO					
Combustible	Diésel (Petróleo)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tracción	4x2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema de Inyección	Inyección Directa Common Rail (CDI)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de motor	4 cilindros con turbo e intercooler	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cilindrada	2.000 cc como mínimo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Potencia	150 hp o superior a 3800 rpm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Torque mínimo	330 N a 1200 - 2400 rpm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tanque de combustible (capacidad)	70 litros o superior.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Rendimiento aproximado	8 kilómetros por litro	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Normas de emisión	Euro V o superior	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Filtrado de combustible	2 filtros (1 decantador de agua)	Cumple	Cumple	Cumple		Cumple
Controlador de tiempo de funcionamiento del motor	Horómetro incorporado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
GPS	Sistema de Monitoreo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.- SISTEMA ELECTRICO	SOLICITADO					
Tipo de encendido.	Convencional.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Voltaje Sistema Eléctrico.	12 volts.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Batería para toda la demanda eléctrica del Vehículo.	Doble y/o Servicio pesado. 12 volt / 100 ah	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (90 Ah)	Cumple
Capacidad Batería Sistema.	5 ah por sobre Equipo original.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema Eléctrico. -	Con alternador y adecuado a la demanda del Sistema. 14 volt / 180 ah	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica alternador y adecuado a la demanda del Sistema. 180 ah)	Cumple
Focos neblineros.	Dos focos Halógenos con haz cortan niebla en posición frontal, protegidos y controlados desde cabina de conducción. -	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica si focos son halógenos y protegidos)	No Cumple (No indica Dos focos Halógenos con haz cortan niebla en posición frontal, protegidos y controlados desde cabina de conducción)	No Cumple (No indica si focos son halógenos y protegidos)
Foco Busca caminos.	Portátil, 12 volts. Al lado del Chofer.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica si foco es portátil)	No Cumple (No indica portátil, al lado del chofer)	No Cumple (No indica si foco es portátil)
Foco auxiliar trasero (faenero).	Un foco, con comando desde la cabina del conductor. Indicar su capacidad en Watts. Ubicado en la parte trasera exterior en posición alta	Cumple (27 Watts)	Cumple (55 Watts)	Cumple (50 watts)	No Cumple (No indica comando desde la cabina del conductor. Indicar su	Cumple (50 watts)

					capacidad en Watts.)	
Luces de retroceso, estacionamiento, emergencia. - Indicadores viraje y luz de cortesía de cabina.	De fabricación. Originales del Vehículo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Luces de Alta Intensidad	En la célula Sanitaria, 4 o más focos LED, de alta y baja Intensidad. Dos focos direccionales sobre la cabeza y tronco del paciente. Comandos en cabina sanitaria.	Cumple	Cumple	No Cumple (indica luces direccionales ubicados en la cabeza y el tronco)	No Cumple (No indica en la célula Sanitaria, 4 o más focos LED, de alta y baja Intensidad. Dos focos direccionales sobre la cabeza y tronco del paciente. Comandos en cabina sanitaria)	No Cumple (indica luces direccionales ubicados en la cabeza y el tronco)
Luces Perimetrales con focos halógenos. Comando en cabina de conducción. -	Sistema LED, con destelladores. Dos Blancos de escena en Sector Lateral central. Cuatro focos Rojo-Azul Sistema LED Intermitentes Secuenciales, dos por cada lateral Superior y dos en parte trasera superior. Certificar que componentes son de 1º nivel, (ideal americano)	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica destelladores. Dos Blancos de escena en Sector Lateral central. Cuatro focos Rojo-Azul Intermitentes Secuenciales, dos por cada lateral Superior y dos en parte trasera superior. Certificar que componentes son de 1º nivel, (ideal americano))	Cumple
Luces de posición reglamentarias	Luces de posición reglamentarias: Dos focos LED alta Intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal. Tercera luz de freno.	Cumple	Cumple	No cumple (no indica cantidad focos LED alta Intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal. Tercera luz de freno.)	No Cumple (No indica Luces de posición reglamentarias: Dos focos LED alta Intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal. Tercera luz de freno.)	No cumple (no indica cantidad focos LED alta Intensidad, color blanco / blanco, ubicados en máscara frontal. Tercera luz de freno.)
Sirena de Alerta multitonial.	Una, Multitonial (cuatro tonos), con sistema de alta voz, 100 watts, de reconocida calidad. -	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Multitonial (cuatro tonos), con sistema de alta voz)	Cumple
Balizas intermitentes y/o destellantes, ubicadas en el techo.	Un barral frontal con sistema LED, color rojo / azul, 12 Volts. Montada sobre base aerodinámica plástico tipo PRFV. En la carrocería del vehículo.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener 12 Volts y ser de plástico tipo PRFV)	No Cumple (No indica Un barral frontal, color rojo / azul, 12 Volts. Montada sobre base aerodinámica plástico tipo PRFV. En la carrocería del vehículo)	No Cumple (No indica tener 12 Volts y ser de plástico tipo PRFV)
Balizas traseras	Dos focos LED alta Intensidad rojo/azul en zona superior de puertas traseras.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica dos focos rojos/azul en zona superior de puertas traseras)	Cumple
Limpia y lava Parabrisas Eléctrico.	De fabricación. Originales del Vehículo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



Alarma de retroceso	De fábrica.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.- SISTEMA DE TRASMISIÓN	SOLICITADO					
Caja de cambios	Mecánica de 6 velocidades hacia adelante y 1 atrás	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tracción	Trasera (4x2 o 4x4)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Dirección	Asistida	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4.- CHASSIS Y PESOS	SOLICITADO					
Tipo de Chasis	Tipo Escalera	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Peso Bruto Vehicular	3.800 kgs. Aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de carga	1.500 kgs. Aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Llantas	De acero aro 16	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5.- CARROCERÍA Y DIMENSIONES	SOLICITADO					
Tipo de Carrocería	Furgón techo alto de fábrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Material	Acero reforzado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parachoques trasero	De acceso con superficie antideslizante	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica acceso con superficie antideslizante)	Cumple
Largo total exterior	5.500 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ancho total exterior sin espejos	1.900 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Alto total exterior	2.500 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Largo inferior zona de célula sanitaria	3.000 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ancho interior	1.700 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Alto interior	1.800 mm aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Volumen zona de cápsula sanitaria	10.5 mts. ² aproximado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parabrisas	Blindado con lamina interior, Todos los vidrios cabina conducción más ventana módulo sanitario y vidrios puertas traseras	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Blindado con lamina interior, Todos los vidrios cabina conducción más ventana módulo sanitario y vidrios puertas traseras)	Cumple
6.- CABINA	SOLICITADO					
Puertas.	2 puertas, Ambulancia.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Espejos exteriores.	Izquierdo y derecho grandes.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tablero con indicadores de alarma y lectura, comandos de sirena, balizas y neblineros.	Consola que integre interruptores eléctricos, sirena electrónica, y espacio para transductor radial, ubicada en la parte central superior del panel de instrumentos del vehículo, que facilite el manejo tanto por parte del conductor como del copiloto. En lo posible integrada al tablero de todos los sistemas vitales, Balizas, Foco faenero, Neblineros y radiocomunicaciones.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica respecto a interruptores eléctricos, sirena electrónica, y espacio para transductor radial, ubicada en la parte central superior del panel de instrumentos del vehículo, que facilite el manejo tanto por parte del conductor como del copiloto. En lo posible integrada al tablero de todos los sistemas vitales, Balizas, Foco faenero, Neblineros y	Cumple

					radiocomunicación)	
Comando de luz, calefacción y ventilación.	De la Célula Sanitaria.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de pasajeros.	Dos, Incluye conductor.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Calefacción, aire fresco y desempañador, viseras contra el sol (izquierda y derecha).	Como standard. equipo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sistema Radiocomunicación	Base de vehículo, dos portátiles y parlante con micrófono en cabina sanitaria (PTT).	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Base de vehículo, dos portátiles y parlante con micrófono en cabina sanitaria (PTT))	Cumple
Asientos.	2 tipo Butaca.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser tipo butaca)	Cumple
Tapiz.	Tapiz Automotriz.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener Tapiz automotriz)	Cumple
Extintores de incendio	Adosado en posición vertical en interior de la cabina. Capacidad de acuerdo a Norma (2 kilos).	Cumple	Cumple	No cumple (No indica estar Adosado en posición vertical en interior de la cabina)	No Cumple (No indica estar Adosado en posición vertical en interior de la cabina. Capacidad de acuerdo a Norma (2 kilos)).	No cumple (No indica estar Adosado en posición vertical en interior de la cabina)
Cinturones de seguridad.	Proporcional al número de pasajeros.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7.- SISTEMA DE FRENOS	SOLICITADO					
De Servicio	De doble circuito con servo-depresión y de disco en las 4 ruedas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser de doble circuito con servo-depresión y de disco en las 4 ruedas)	Cumple
Sistemas de eficiencia de frenado	ESP: Control de estabilidad con: ABS: Antibloqueo de frenos ASR: Control de tracción BAS: Servofreno de emergencia EBV: Distribución electrónica de fuerza de frenado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Airbag	Para el conductor y copiloto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
De Estacionamiento	Accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica si estacionamiento es por accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras)	No Cumple (No indica tener accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras)	No Cumple (No indica si estacionamiento es por accionamiento mecánico por palanca hacia las ruedas traseras)
8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN	SOLICITADO					
Suspensión Delantera/Trasera	Debe ser adecuada para traslado sanitario, especialmente poli traumatizado, debe ser blanda, con el mínimo de vibración	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser adecuada para traslado sanitario, especialmente poli traumatizado, debe ser blanda, con el	Cumple



					mínimo de vibración)	
Suspensión Delantera	Independiente; eje delantero de conjuntos telescópicos con ballesta transversal parabólica y estabilizador.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Suspensión Trasera	Eje trasero rígido, con suspensión de ballesta Trasera.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Amortiguadores	2 delanteros y 2 traseros hidráulicos de doble efecto	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica 2 delanteros y 2 traseros hidráulicos de doble efecto)	Cumple
Barra estabilizadora	Delantera y trasera	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Delantera y trasera)	Cumple
9.- CÉLULA SANITARIA						
SOLICITADO						
Dimensiones	Largo 3.000 mm. Aprox. (+/- 500 mm) Alto 1.800 mm. Aprox. (+/- 200 mm) Ancho 1.700 mm. Aprox. (+/- 300mm)	Cumple*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ventana de Intercomunicación	Ventana automotriz de apertura horizontal que permita comunicación desde cabina de conducción hacia cabina sanitaria.	Cumple*	Cumple	No Cumple (Ventana de apertura vertical)	No Cumple (No indica Ventana automotriz de apertura horizontal que permita comunicación desde cabina de conducción hacia cabina sanitaria)	No Cumple (Ventana de apertura vertical)
Puertas Nº y ubicación.	1 Puerta lateral.	Cumple*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacidad de pasajeros.	Mínimo, 4 Incluyendo al paciente.	Cumple*	Cumple	Cumple	No cumple (3 pasajeros)	Cumple
Portón trasero.	Das puertas de batiente, con anclaje lateral de seguridad, cada una con vidrio fijo y pavonado autoadhesivo. Incluir pisadera original de fábrica con superficie antideslizante.	Cumple*	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener dos puertas de batiente, con anclaje lateral de seguridad, cada una con vidrio fijo y pavonado autoadhesivo. Incluir pisadera original de fábrica con superficie antideslizante)	Cumple
Asiento paramédico.	Butaca Ergonómica con apoya cabeza. Cojinería de poliuretano inyectado, tapizada en cuero sintético, resistente al roce, humedad, fluidos y de fácil limpieza. Instalada a la cabecera de la camilla sobre estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y respaldo con apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera mínimo 3	Cumple*	Cumple	No Cumple (No indica una Butaca Ergonómica con apoyacabeza. Cojinería de poliuretano inyectado. Instalada a la cabecera de la camilla sobre estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y respaldo con	No Cumple (No indica una butaca Ergonómica con apoyacabeza. Cojinería de poliuretano inyectado, tapizada en cuero sintético, resistente al roce, humedad, fluidos y de fácil limpieza. Instalada a la cabecera de la camilla sobre	No Cumple (No indica una Butaca Ergonómica con apoyacabeza. Cojinería de poliuretano inyectado. Instalada a la cabecera de la camilla sobre estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y

	<p>posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Cinturón de seguridad de 3 puntas con dispositivo retráctil automático para facilitar la movilidad del intervisor, Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible Debe incluir un cinturón de seguridad de 3 puntas retráctil y autoajustable.</p>			<p>apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera mínimo 3 posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible Debe incluir un cinturón de seguridad de 3 puntas retráctil y autoajustable)</p>	<p>estructura de acero solidaria al piso y sujeta firmemente con pernos graduados. Asiento y respaldo con apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera manual mínimo 3 posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Cinturón de seguridad de 3 puntas con dispositivo retráctil automático para facilitar la movilidad del intervisor, Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible Debe incluir un cinturón de seguridad y autoajustable)</p>	<p>respaldo con apoyos laterales y soporte lumbar. Regulación longitudinal por corredera mínimo 3 posiciones, respaldo con regulación por cremallera manual mínimo 3 posiciones. Certificado. La altura de la butaca no debe superar más de 10 cm la altura de la camilla. (Distancia adecuada para abordar al paciente). La separación entre la butaca y la camilla debe ser de a lo menos 30 cm (lugar para ubicar los pies del operador) Con respaldo abatible Debe incluir un cinturón de seguridad de 3 puntas retráctil y autoajustable)</p>
Piso.	<p>Terclado marino de mínimo 10 mm. de espesor. El revestimiento debe ser plano, continuo, sin juntas ni uniones, de alto tráfico, lavable e impermeable, de vinilo de excelencia (tipo tarkett o equivalente). Debe sobrepasar en al menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble. Piso debe estar reforzado con plancha de acero inoxidable en zonas de alto tráfico: Acceso trasero y lateral. Debe tener evacuación controlada para eliminación de desechos biológicos durante el aseo.</p>	Cumple*	Cumple	<p>No Cumple (no indica sobrepasar en al menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble)</p>	<p>No Cumple (No indica ser Terclado marino de mínimo 10 mm. de espesor. El revestimiento debe ser plano, continuo, sin juntas ni uniones e impermeable. Debe sobrepasar en al menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble. Piso debe estar reforzado con plancha de acero inoxidable en zonas de alto</p>	<p>No Cumple (no indica sobrepasar en al menos 5 cm los bordes y las paredes del área de carga, doblado siguiendo la curva del mueble)</p>



					Tráfico: Acceso trasero y lateral. Debe tener evacuación controlada para eliminación de desechos biológicos durante el aseo)	
Paredes laterales y techo.	Interior área paciente (Revestimiento interior). Paredes completas y cielo en material lavable, que no acumule residuos, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado (sello perimetral). En fibra de vidrio. Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente). Debe instalarse entre carrocería y paneles interiores de la cabina sanitaria.	Cumple*	Cumple	No Cumple (No indica respecto a Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente)	No Cumple No indica paredes completas y cielo en material lavable, que no acumule residuos, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado (sello perimetral). En fibra de vidrio. Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente). Debe instalarse entre carrocería y paneles interiores de la cabina sanitaria)	No Cumple (No indica respecto a Aislamiento interior termo acústico ignífugo, de lana de vidrio de al menos de 40 mm de espesor (tipo ducto roll o equivalente)
Portasueros.	Sistema de aluminio, instalado en el cielo de la cabina sanitaria compuesto por : Dos (2) soportes para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo	Cumple*	Cumple	No Cumple (no indica tener para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo)	No Cumple (No indica ser un Sistema de aluminio, compuesto por : Dos (2) soportes para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo)	No Cumple (no indica tener para 4 sueros ubicados en zona media de la camilla en el techo)
Barras de Soporte y Pasamanos.	Una (1) barra vertical de soporte de equipos con al menos tres apoyos, fijada en zona estructural del móvil. Un (1) pasamanos metálico fabricado en aluminio, instalado en cielo de módulo sanitario dispuesto de forma ergonómica. Un (1) pasamanos metálico fabricado en aluminio, para fácil acceso por puerta lateral. Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica respecto a barra vertical de soporte de equipos con al menos tres apoyos y tener Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la camilla. Debe existir otro adosado a las	No indica tener Una (1) barra vertical de soporte de equipos con al menos tres apoyos, fijada en zona estructural del móvil. Un (1) pasamanos metálico fabricado en aluminio, instalado en cielo de módulo sanitario dispuesto de forma ergonómica. Un (1) pasamanos metálico	No Cumple (No indica respecto a barra vertical de soporte de equipos con al menos tres apoyos y tener Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la camilla. Debe existir otro adosado a las

	camilla. Debe existir otro adosado a las gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla.			gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla)	fabricado en aluminio, para fácil acceso por pueria lateral. Pasamanos flexibles (3) en acceso lateral y trasero Aluminio, seis distintas ubicaciones, uno debe ser de piso a techo y estar al lado del asiento longitudinal a la altura de la cabeza de la camilla. Debe existir otro adosado a las gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla)	gavetas de insumos, al nivel de la cabecera de la camilla)
Asiento longitudinal	Estructurado en acero y fibra de vidrio, para tres personas, cubierta acolchada y tapizada y respaldo de apoyo. Estar ubicado al costado derecho del área del paciente. Remate al piso curvo para continuarse con recubrimiento de piso. Cinturones de seguridad de tres puntas. Deberá considerar tres cinturones de seguridad de 3 puntas, retráctil, considerando la mayor fijación del usuario en el sentido de desplazamiento del vehículo. Amplio compartimiento para almacenaje de equipos. Con acceso desde tapa superior, Nicho para el transporte de Equipos o Insumos menores. Incorporar espacios para recipiente desechos generales y materiales cortopunzantes.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica estar Estructurado en acero y fibra de vidrio, para tres personas, cubierta acolchada y tapizada y respaldo de apoyo. Estar ubicado al costado derecho del área del paciente. Remate al piso curvo para continuarse con recubrimiento de piso. Cinturones de seguridad de tres puntas. Deberá considerar tres cinturones de seguridad de 3 puntas, retráctil, considerando la mayor fijación del usuario en el sentido de desplazamiento del vehículo. Amplio compartiment o para almacenaje de equipos. Con acceso desde tapa superior, Nicho para el transporte de Equipos o Insumos menores)	Cumple
Dispositivo transporte segundo paciente:	Dispositivo desarrollado para transportar tabla espinal con un segundo paciente dispuesto en el asiento longitudinal, sujeto por un cinturón de seguridad.	Cumple	No Cumple (Dispuesto en zona baja de mueble anaquel médico)	Cumple	No Cumple (No indica Dispositivo desarrollado para transportar tabla espinal)	Cumple



					con un segundo paciente, sujeto por un cinturón de seguridad)	
Ventilación.	Extractor de aire eléctrico, centrífugo de gran caudal, ubicado en el techo de la cabina sanitaria, lejos de la cabeza del paciente.	Cumple	Cumple	No cumple (No indica que ubicación está lejos de la cabeza del paciente)	No cumple (No indica que ubicación está lejos de la cabeza del paciente)	
Ventilador para el paciente.	Eléctrico 12 Volts	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Vidrios de seguridad.	Con vidrio blanco o esmerilado en paredes laterales. (Ventana de corredera).	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple (No indica tener vidrio blanco o esmerilado en paredes laterales. (Ventana de corredera)	Cumple
Calefacción	Independiente, por circuito cerrado de agua caliente, dos velocidades y comando en cabina sanitaria, salida del aire en la parte inferior del mueble sanitario, lejos de la cabeza del paciente.	Cumple	Cumple	No cumple (No indica estar comando en cabina sanitaria, salida del aire en la parte inferior del mueble sanitario, lejos de la cabeza del paciente)	No cumple (No indica ser independiente, por circuito cerrado de agua caliente, dos velocidades y comando en cabina sanitaria, salida del aire en la parte inferior del mueble sanitario, lejos de la cabeza del paciente)	
Red Eléctrica	220 volts. Instalada en compartimiento sanitario, con 4 enchufes hembras convencionales para equipos médicos.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple (No indica estar instalada en compartimiento sanitario, con 4 enchufes hembras convencionales para equipos médicos)	Cumple
Compartimiento paciente y cabina chofer.	Panel divisorio de cabina y área paciente: No considera vano de paso. Fijación superior e inferior. Deberá contar con ventana de comunicación entre la cabina sanitaria y de conducción con cierre con vidrio o similar pavonado. Panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado.	Cumple	Cumple	No cumple (No indica panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado).	No cumple (No indica tener un panel divisorio de cabina y área paciente: No considera vano de paso. Fijación superior e inferior. Deberá contar con ventana de comunicación entre la cabina sanitaria y de conducción con cierre con vidrio o similar pavonado. Panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado).	No cumple (No indica panel divisorio en material antiséptico, resistente, de fácil limpieza y debidamente sellado).

					fácil limpieza y debidamente sellado)	
10.- EQUIPAMIENTO CÉLULA SANITARIA	SOLICITADO					
Camilla.	Patas altas retráctiles, operable por una persona, capacidad 250 Kgs. Construida en duraluminio tubular, seis ruedas, dos rotatorias. Respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Debe tener sistema Trendelenburg y Sisma anclaje alta seguridad 10G. Colchoneta de material lavable, antiséptico y resistente. Dispositivo de anclaje, sujeción al piso y manilla desenganche rápido, barandas laterales abatibles y cinturones de seguridad. Anclaje compatible para traslado de incubadora de transporte. Ruedas de 200 mm de diámetro	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener seis ruedas, dos rotatorias. Respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Debe tener sistema Trendelenburg)	No Cumple (No indica tener seis ruedas, dos rotatorias. Respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Debe tener sistema Trendelenburg)	No Cumple (No indica tener seis ruedas, dos rotatorias. Respaldo abatible, que permita a lo menos seis posiciones. Debe tener sistema Trendelenburg)
Camilla Portátil	Enrollable, cubierta resistente y lavable. Asas de transporte.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener Asas de transporte)	No Cumple (No indica tener cubierta resistente y lavable. Asas de transporte)	No Cumple (No indica tener Asas de transporte)
Silla de Ruedas Plegable	Silla de ruedas plegable, con dispositivo que permita su fijación en cabina sanitaria.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Equipo Oxigenoterapia Portátil.	*Soporte de sujeción de aluminio para camilla. *01 cilindro tipo D (con Carga) *Regulador con flujómetro tipo PIN INDEX, humidificador y válvula.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener *Soporte de sujeción de aluminio para camilla. *01 cilindro tipo D (con Carga) *Regulador con flujómetro tipo PIN INDEX, humidificador y válvula)	Cumple
Red Oxígeno Central	Red de Oxígeno de alta presión con regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada en mueble médico, debe incluir regulador, flujómetro y humidificador. - 01 cilindro de Oxígeno 9 mts.³, válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad.	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad)	No Cumple (No indica tener Red de Oxígeno de alta presión con regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada en mueble médico, debe incluir regulador, flujómetro y humidificador. -	No Cumple (No indica válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad)



					01 cilindro de Oxígeno 9 mts. ³ , válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad)	
Anclaje y carro porta cilindro de oxígeno	Anclaje metálico para cilindro de oxígeno de 9 mts. ³ , ubicado en zona de máxima seguridad entre cabina de conducción y compartimiento sanitario fijo al piso, atrás del panel divisorio y transversal al vehículo. Incluye carro desmontable desde su anclaje junto al cilindro, permitiendo el traslado de éste y una operación de recambio segura y sin esfuerzos.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener anclaje metálico para cilindro de oxígeno de 9 mts. ³ , ubicado en zona de máxima seguridad entre cabina de conducción y compartimiento sanitario fijo al piso, atrás del panel divisorio y transversal al vehículo. Incluye carro desmontable desde su anclaje junto al cilindro, permitiendo el traslado de éste y una operación de recambio segura y sin esfuerzos)	Cumple
Mueble anaquel Médico	Mueble Lateral izquierdo, construido de piso a cielo, de todo el ancho del vehículo. Debe ser construido en material que permita su lavado o limpieza profunda. Debe contar sistema de almacenaje de fácil acceso para los usuarios, incluso en movimiento, con habitáculos con puertas de material transparente deslizable vertical u horizontalmente y divisiones interiores para almacenar insumos médicos, indicar el número de habitáculos disponibles. El Sistema de almacenaje debe ser de material lavable y permitir una limpieza profunda, con bordes que eviten la caída de objetos, rotulable, resistente al impacto. Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abatir que permita posiciones para cierre completo y ventilación. Debe tener	Cumple	Cumple*	No Cumple (No indica Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abatir que permita posiciones para cierre completo y ventilación. Debe tener a lo menos dos bandejas (2) ajustables)	No Cumple (No indica Mueble Lateral izquierdo, construido de piso a cielo, de todo el ancho del vehículo. Debe ser construido en material que permita su lavado o limpieza profunda. Debe contar sistema de almacenaje de fácil acceso para los usuarios, incluso en movimiento, con habitáculos con puertas de material transparente deslizable vertical u horizontalmente y divisiones interiores para almacenar insumos médicos, indicar el número de	No Cumple (No indica Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abatir que permita posiciones para cierre completo y ventilación. Debe tener a lo menos dos bandejas (2) ajustables)

	<p>a lo menos dos bandejas (2) ajustables. Debe tener una cubierta de trabajo al lado del asiento del paramédico, con bordes redondeados, con barandas en todo el frente para evitar la caída de objetos. En su parte superior debe incorporar paneles independientes uno para controles generales y otro para puestos de toma oxígeno y vacío.</p>				<p>habitáculos disponibles. El Sistema de almacenaje debe ser de material lavable y permitir una limpieza profunda, con bordes que eviten la caída de objetos, rotulable, resistente al Impacto. Un (1) armario lateral con puerta operación vertical o de abatir que permita posiciones para cierre completo y ventilación. Debe tener a lo menos dos bandejas (2) ajustables. Debe tener una cubierta de trabajo al lado del asiento del paramédico, con bordes redondeados, con barandas en todo el frente para evitar la caída de objetos. En su parte superior debe incorporar paneles independientes uno para controles generales y otro para puestos de toma oxígeno y vacío)</p>	
Mueble modular	<p>Fabricado en material lavable, ubicado en la división de las cabinas de conducción y sanitaria. Con divisiones para guardar 2 bolsos de reanimación. Provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio.</p>	Cumple	Cumple	<p>No Cumple (No indica estar provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio)</p>	<p>No Cumple (No indica ser fabricado en material lavable, ubicado en la división de las cabinas de conducción y sanitaria. Con divisiones para guardar 2 bolsos de reanimación. Provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio)</p>	<p>No Cumple (No indica estar provisto de correas con velcro ajustable y fijas al mueble. En su parte inferior capacidad para almacenar 01 Cilindro de Oxígeno de 9 mts³ con sus fijaciones y anclaje metálico, y sistema que facilite su movimiento para recambio)</p>



					sistema que facilite su movimiento para recambio)	
Kit de Férulas	Seminirrigidas para extremidades fracturadas con fijación con velcro. Adulto y pediátrico 5 Unidades para brazos y piernas con bolso de transporte.	Cumple	Cumple	No Cumple (no indica férulas Adulto y pediátrico)	No Cumple (No indica ser Semirrigidas, para extremidades fracturadas con fijación con velcro. Adulto y pediátrico 5 unidades para brazos y piernas con bolso de transporte)	No Cumple (no indica férulas Adulto y pediátrico)
Inmovilizador de Cabeza	01 Unidades Universales de cabeza, con cojines laterales perforados	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica 01 Unidades Universales de cabeza, con cojines laterales perforados)	Cumple
Kit Tablas de Espinales	Un largo adulto de material plástico resistente, radio lúcida capacidad de 250 kg. Orificios necesarios para instalar correas para inmovilizar (3 incorporadas) y base de inmovilizador de cabeza. Una Corta de extricación y una para uso pediátrico, fabricadas en plástico resistente, lavable. Con correas de seguridad para cada tabla y anclaje de traslado.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Un largo adulto de material plástico resistente, radio lúcida capacidad de 250 kg. Orificios necesarios para instalar correas para inmovilizar (3 incorporadas) y base de inmovilizador de cabeza. Una Corta de extricación y una para uso pediátrico, fabricadas en plástico resistente, lavable. Con correas de seguridad para cada tabla y anclaje de traslado)	Cumple
Kit Collares Cervicales	6 unidades regulables de 4 posiciones, 3 Adulto y 3 Pediátrico.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser regulables de 4 posiciones)	Cumple
Kit Resucitadores Manuales	Autoclavables, medidas adultas, pediátricas. Fabricado en silicona, válvula de seguridad. Entrada lateral para Oxígeno. Con bolsa reservorio y mascarilla, válvulas de PEEP desmontables	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica estar fabricado en silicona)	No Cumple (No indica ser Autoclavables.. Fabricado en silicona, válvula de seguridad. Entrada lateral para Oxígeno. Con bolsa reservorio y mascarilla, válvulas de PEEP desmontables)	No Cumple (No indica estar fabricado en silicona)
Esfigmomanómetro	Dos Tipo reloj anerolde portátil resistente a golpes.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser de dos Tipo reloj anerolde portátil resistente a golpes)	Cumple

Fonendoscopio Adulto y Neonatal (1 cada uno)	Doble cápsula	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Sei Sábanas y frazadas	De Una Plaza, Dos Sábanas, dos frazadas y dos sabanillas.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (Falta las medidas y 02 sabanillas)	Cumple
Recipiente para desechos	Tres (3) recipientes para desechos, fabricado en aluminio electropintado, lavable, desinfectable, con señalética según corresponda, de 10 lts c/u afianzado al compartimiento sanitario. - Contenedor N°1 color amarillo para residuos contaminados con fluidos de riesgo biológico. - Contenedor N°2 color negro para basura doméstica. - Contenedor N° 3 blanco para ropa o utensilios contaminados; como bolsa máscara, hojas de laringoscopios hasta que puedan ser descontaminadas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Tres (3) recipientes para desechos, fabricado en aluminio electropintado, lavable, desinfectable, con señalética según corresponda, de 10 lts c/u afianzado al compartimiento sanitario. Contenedor N°1 color amarillo para residuos contaminados con fluidos de riesgo biológico. Contenedor N°2 color negro para basura doméstica. Contenedor N° 3 blanco para ropa o utensilios contaminados; como bolsa máscara, hojas de laringoscopios hasta que puedan ser descontaminadas)	Cumple
Dispensador desinfectante	Incluye dosificador, soporte y 02 carga	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica incluir dosificador, soporte y 02 carga)	Cumple
11.- SISTEMA ELÉCTRICO ÁREA PACIENTE	SOLICITADO					
Central de Comandos Eléctricos	Sistema Relé-fusible de alta capacidad, teclas con luz piloto y leyendas de identificación.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Sistema Relé-fusible de alta capacidad, teclas con luz piloto y leyendas de identificación)	Cumple
Panel Central de Comandos	Para equipos adicionales.-	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Toma corrientes 12 Vols 16 amps.	Tipo plug Dos unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Tipo plug)	Cumple
Batería Auxiliar	Batería de 100 Amp. De ciclo profundo (libre mantención) con puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga Inversor	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga Inversor)	No Cumple (No indica tener puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga Inversor)	No Cumple (No indica puenteador, instalada con separador de carga y corta corriente. Sistema para arranques de emergencia y recarga Inversor)

12.- OTRAS CARACTERÍSTICAS	SOLICITADO				recarga inversor)	
Neumáticos.	6 Telas medida standard.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica tener 6 Telas medida standard)	Cumple
Rueda de repuesto.	Si, Acceso externo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Gata y llave de rueda.	De fabricación y además otras herramientas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Radio AM/FM – CD-USB	Si, Original de fábrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Pisos de goma en cabina conducción	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Kit de seguridad	Boliquín, triángulo y chaleco reflectante	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Gata y llave de rueda	Si, según Norma	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Incluir logo institucional "Gobierno Regional de Maule"	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Incluir logo institucional	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos del vehículo al día	Permiso de circulación, seguro obligatorio, revisión técnica homologada, inscripción R.N.V.M, pago TAG o pase diario de traslado y Pago impuesto verde si corresponde	Cumple	Cumple	Cumple		Cumple
Estanque de combustible lleno	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Manual del uso en español	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Capacitación	Si	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Lugar Entrega del Vehículo	Villa Alegre (A confirmar dirección al momento de la entrega)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13.- CARACTERÍSTICAS SISTEMA RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL	SOLICITADO					
01 SISTEMA MÓVIL	<ul style="list-style-type: none"> Transceptor Base Digital (32 Canales).- Antena Móvil, similar a ¼ de onda por altura. Instalación y Programación de Frecuencia.- 	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica Transceptor Base Digital (32 Canales), Antena Móvil, similar a ¼ de onda por altura, Instalación y Programación de Frecuencia)	Cumple
01 TRANSCPTOR PORTÁTIL	<ul style="list-style-type: none"> 146 - 174 MHz, 16 canales, 5 Watts de potencia, scanner, que incluya Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa. 	Cumple	Cumple	No Cumple (No Indica Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa)	No Cumple (No indica 146 - 174 MHz, 16 canales, 5 Watts de potencia, scanner, que incluya Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa)	No Cumple (No indica Pack de batería lón litio, con cargador de sobremesa, antena flexible, pinza de cinturón, con micrófono de solapa)

01 KIT MICRÓFONO Y PARLANTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Instalado en cabina sanitaria en panel divisorio de contra cabina.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14.- OTRAS CARACTERÍSTICAS	SOLICITADO					
Red Eléctrica 220 Volts.	En compartimiento Sanitario, protegida por automático de 10 amp., tres enchufes hembras convencionales - cable alargador 20 mts para 2.000 watts y toma corriente exterior con tapa de protección para intemperie.-	Cumple	Cumple	Cumple (no indica amp)	No Cumple (No indica estar en compartiment o Sanitario, protegida por automático de 10 amp., tres enchufes hembras convencionales -cable alargador 20 mts para 2.000 watts y toma corriente exterior con tapa de protección para intemperie)	Cumple
Inversor / Cargador de Corriente	2.000 watts. (Efectivo o medio) o superior de 12v a 220 Volts. (Que permita conversión de corriente para carga de equipos de radio portátil y equipos de uso frecuente como bombas de infusión, entre otras.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica ser superior de 12v a 220 Volts. (Que permita conversión de corriente para carga de equipos de radio portátil y equipos de uso frecuente como bombas de infusión, entre otras)	Cumple
Aire Acondicionado Frío-Frío.-	Sistema de aire acondicionado original de fábrica, de 12v, frío, doble, instalado en compartimiento sanitario y cabina conducción con comandos independientes. Delantero (Cabina) 7.000 BTU Trasero (sanitario) 23.000 BTU	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica respecto a Sistema de aire acondicionado original de fábrica, de 12v, frío, doble, instalado en compartimiento sanitario y cabina conducción con comandos independientes. Delantero (Cabina) 7.000 BTU Trasero (sanitario) 23.000 BTU)	Cumple	No Cumple (No indica respecto a Sistema de aire acondicionado original de fábrica, de 12v, frío, doble, instalado en compartiment o sanitario y cabina conducción con comandos independientes , Delantero (Cabina) 7.000 BTU Trasero (sanitario) 23.000 BTU)
Planos	Incluir planos y fotografías que permitan conocer claramente la distribución de muebles y equipos solicitados. Incluir diagrama eléctrico unilineal del sistema eléctrico original y el adicional. Incluir memoria de cálculo del sistema de alimentación y distribución, además cálculo de secciones de cableado eléctrico.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Red Oxígeno Central	Red de Oxígeno de alta presión con	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple

	regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada en mueble médico, debe incluir regulador, flujo metro y humidificador.-				(No indica tener una red de Oxígeno de alta presión con regulador, dos puestos de Toma compatible con DISS instalada en mueble médico, debe incluir regulador, flujo metro y humidificador)	
	01 cilindro de Oxígeno 9 mts. ³ , válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (No indica 01 cilindro de Oxígeno 9 mts. ³ , válvula H, instalado con anclaje metálico y sistema para fácil desmontaje en Mueble modular, con ventanilla de visibilidad)	Cumple

Cumple*: Posterior a consulta a través del foro Inverso.

Observaciones:

- Las empresas "CONVERSIONES SAN JOSE SPA", "COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS MINEROS Y FLOTISTAS LTDA"., "COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL RIO SPA" Y L.J. AUTOMOTRIZ LTDA. no cumple con la totalidad de las características técnicas mínimas solicitadas, según lo indicado en cuadro precedente, considerándose su oferta inadmisibile y quedando excluida para continuar en evaluación, según lo estipulado en el punto N° 14.2.1 párrafo 2, en donde se dice que "Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas serán excluidas de la evaluación".

B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará las ofertas conforme a los criterios y ponderaciones establecidos en las bases de licitación:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Plazo de Entrega	25 Puntos
Servicio Técnico Post Venta y Garantía	30 Puntos
Precio	40 Puntos
Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta	5 Puntos

a) Plazo de Entrega: 25 Puntos

Plazo de Entrega		BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Oferta (s) con menor plazo de entrega	(25 Puntos)	1 día
2° Oferta(s) con menor plazo de entrega	(20 Puntos)	
3° Oferta(s) con menor plazo de entrega	(15 Puntos)	
Resto de las ofertas	(10 Puntos)	
PUNTAJE		25 puntos

www.goremaule.cl

I Norte N°711 - 71 2 205201- 71 2 205269 - 71 2.205288 - TALCA

b) Servicio Técnico de Post Venta y Garantía: 30 Puntos

Servicio Técnico de Post Venta 10 Puntos

Servicio Técnico de Post Venta	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Servicio Técnico Autorizado para los vehículos ofertado dentro de la Región del Maule (10 Puntos)	Servicio Técnico Autorizado para los vehículos ofertado dentro de la Región del Maule
Servicio Técnico Autorizado para los vehículos ofertado fuera de la Región del Maule (5 Puntos)	
PUNTAJE	10 puntos

Garantía 20 Puntos

Garantía	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Superior a 24 meses. (20 Puntos)	25 meses
Superior a 12 meses y hasta 24 meses. (15 Puntos)	
Hasta 12 meses. (10 Puntos)	
PUNTAJE	20 puntos

c) Precio: 40 Puntos

Precio	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
$I = (P_{\text{mín}}/P) \times I_{\text{máx.}}$ Donde: I : Puntaje de la oferta, se expresará en dos decimales P _{mín} : Precio de la oferta de menor costo P : Precio de la oferta en evaluación I _{máx} : Puntaje máximo correspondiente a este criterio	\$ 77.100.000.-
PUNTAJE	40 Puntos

d) Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta: 5 Puntos

Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Presentación total de los antecedentes solicitados sin errores u omisiones formales (5 Puntos)	El oferente presenta los antecedentes omitidos en el plazo señalado en el foro inverso.
El oferente presenta los antecedentes omitidos en el plazo señalado en el foro inverso. (3 Puntos)	
PUNTAJE	3 Puntos



PUNTAJES TOTALES

Critério de Evaluación	Puntuación Máx.	BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA
Plazo de Entrega	25 puntos	25 puntos
Servicio Técnico Post Venta y Garantía	30 puntos	30 puntos
Precio	40 puntos	40 puntos
Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación de la Oferta	5 puntos	3 puntos
PUNTAJE	100 puntos	98 puntos

C.- ANÁLISIS POSTERIOR DE LOS ANTECEDENTES:


Según lo establecido en la Res (E) N° 6968 de fecha 14 de noviembre del 2022, el presupuesto aprobado para el proyecto, con impuestos incluido, es el siguiente:

Código BIP	Nombre proyecto	Monto Aprobado \$
40.026.686	REPOSICIÓN DE 1 AMBULANCIA PARA DPTO. SALUD, COMUNA DE VILLA ALEGRE.	\$ 114.240.000.-

D.- SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN

Por todo lo antes expuesto y los antecedentes presentados, se sugiere salvo su mejor parecer, adjudicar la licitación pública ID 1596-15-LP23, al oferente que cumplió con todos los requisitos administrativos, técnicos y obtuvo el mayor puntaje ponderado, según los criterios de evaluación establecidos en las bases administrativas de esta licitación, correspondiente a la empresa: **BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA**, RUT **87.927.900-3**, por un valor de **\$ 77.100.000.- IVA incluido**, en un plazo de **01 día corrido**, contados desde la fecha de la Resolución que aprueba contrato.


Diego Moraga Zuñiga
Comisión Evaluadora según Resolución (E) N° 536/2023
Profesional Unidad de Administración de Programas

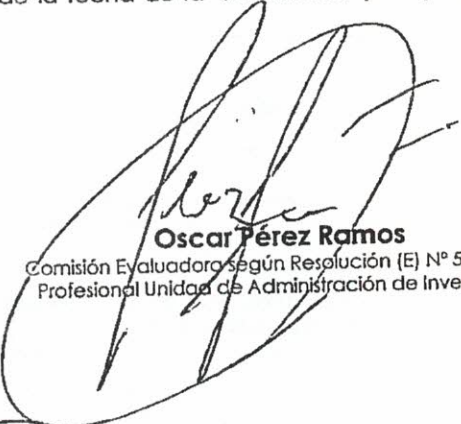
Oscar Pérez Ramos
Comisión Evaluadora según Resolución (E) N° 536/2023
Profesional Unidad de Administración de Inversiones


Rita Rojas Parra
Comisión Evaluadora según Resolución (E) N° 536/2023
Profesional Unidad de Administración de Adquisiciones